

مقاله مروری

بررسی روش‌های شناسایی بیماری آلزایمر با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن

محمود سیف‌الهی^۱ (Ph.D Candidate)، هادی سلطانی‌زاده^۱ (Ph.D)، افسون حسنی مهربان^۲ (Ph.D)، فاطمه خمسه^۳ (M.D)

۱- گروه مهندسی الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

۲- گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

۳- پخش مغز و اعصاب، انجمن آلزایمر ایران، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۷/۳

h_soltanizadeh@semnan.ac.ir

* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۶۲۷۵۳۰۰

چکیده

هدف: شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر به عنوان یک بیماری تخریب‌گر مغزی و شایع‌ترین عامل دمанс در سالمندان، با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن مورد توجه ویژه محققین در سال‌های اخیر قرار گرفته است. زیرا این روش نوین غیرتهاجمی، کم‌هزینه‌تر و قابل انجام در محیط‌های غیرکلینیکی و آزمایشگاهی است. بنابراین، در این مقاله مروری، شناسایی بیماری آلزایمر به‌وسیله آنالیز الگوی راه رفتن با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در مطالعات پیشین، بررسی شد.

مواد و روش‌ها: جستجوی مقالات پیشین در پایگاه‌های اطلاعاتی مانند Springer، IEEE، Pubmed و Google Scholar از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ میلادی، مقالات مناسب بر اساس معیارهایی مانند تمکن مطالعه بر روی سالمندان با بیماری آلزایمر یا اختلالات شناختی خفیف، شناسایی و ارزیابی بیماری آلزایمر، استفاده از فناوری سنسورها برای ثبت راه رفتن، برای بررسی انتخاب شدند.

یافته‌ها: با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن به‌وسیله ابزارهای نوین مبتنی بر سنسورها و فناوری اطلاعات می‌توان به شناسایی بیماری آلزایمر، حتی در مراحل اولیه و نیز در مرحله اختلالات شناختی خفیف پرداخت. همچنین با تکیه بر ترکیب فناوری‌های مختلف سنسورها و استفاده از روش‌های هوش مصنوعی امکان ارزیابی کمی و شناسایی دقیق تر بیماری فراهم می‌شود.

نتیجه‌گیری: اگر چه آنالیز الگوی راه رفتن می‌تواند ابزار جدیدی برای شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر باشد، اما برای استفاده از آن به عنوان یک ابزار مطمئن در کلینیک‌ها نیاز به توسعه و بهبود آن با تکیه بر فناوری سنسورها و هوش مصنوعی دارد.

واژه‌های کلیدی: بیماری آلزایمر، الگوی راه رفتن، فناوری اطلاعات، پردازش تصویر به کمک رایانه، یادگیری ماشین، هوش مصنوعی

آنالیزات و بررسی‌های علوم اعصاب و روان‌پزشکی، تصویربرداری مغزی، تست‌های کلینیکی و ... قابل شناسایی است. در اکثر مواقع علائم بیماری آلزایمر در مراحل اولیه ناشی از کهولت سن آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و به خاطر عواملی مانند فرآیند طولانی شناسایی به‌وسیله روش‌های پزشکی حاضر و هزینه‌ها، معمولاً تا شدید نشدن وضعیت آن‌ها مورد توجه جدی و آزمایشات کلینیکی قرار نمی‌گیرند. بنابراین باید روش‌های غیرتهاجمی، کم‌هزینه و ساده که قابلیت شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر در مراحل خفیف این بیماری و حتی در مرحله اختلالات شناختی خفیف را داشته باشند، مورد توجه جدی قرار گیرد. به همین دلیل با توجه به یافته‌های مطالعات انجام شده در سال‌های اخیر، آنالیز الگوی راه رفتن به عنوان یکی از این

مقدمه

بیماری آلزایمر (Alzheimer's Disease, AD) یک بیماری مغزی تخریب‌گر و شایع‌ترین شکل زوال عقل است [۱,۲]. بیماری آلزایمر معمول‌ترین نوع دمанс است که با کاهش حافظه و مهارت‌های تفکر مشخص می‌شود و توانایی‌های شخص را در انجام فعالیت‌های روزانه تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش سن به عنوان مهم‌ترین فاکتور ریسک برای بیماری آلزایمر شمرده می‌شود [۳]. فرآیند رشد جمعیت مبتلا به بیماری آلزایمر در جهان با سرعت بیشتری در حال افزایش است [۴]. برای شناسایی بیماری آلزایمر یک روش ثابت به تنهایی وجود ندارد، اما به‌طور کلی این بیماری به‌وسیله شواهد جمع‌آوری شده از سوابق پزشکی خانوادگی، پرسش از بستگان و مراقبان فرد،

(MCI) و گروه سالم‌مندان با بیماری آلزایمر برای بررسی این موضوع توسط محققین در سال‌های اخیر برای تشخیص و ارزیابی بیماری آلزایمر به‌وسیله آنالیز الگوی راه رفتن به عنوان ابزاری نوین در کنار سایر روش‌های تشخیص برای این بیماری شده است.

با وجود استفاده آسان و گسترش از روش‌های ارزیابی مبتنی بر مشاهده حضوری برای شناسایی بیماری آلزایمر با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن و سایر فعالیت‌های روزمره زندگی، این روش‌ها، ضمن زمان بر بودن، دارای دقت و حساسیت کم در سنجش و ارزیابی دقیق افراد خواهد بود و همچنین عمدتاً توانایی آن‌ها به اطلاعات کلی محدود می‌شود. در مقابل ابزارهای تکنولوژیکی مبتنی بر سنسورها و فناوری اطلاعات، امکان مانیتورینگ افراد را برای ارزیابی عملکرد به صورت دقیق و خاص فراهم کرده است. این ابزارها با فراهم کردن امکان ضبط کامل و دقیق فعالیت‌های افراد، امکان شناسایی اختلالات شناختی ناشی از بیماری‌هایی مانند بیماری آلزایمر را فراهم می‌کنند [۸]. بنابراین در این مقاله مروری کاربرد ابزارهای نوین مبتنی بر سنسورها و فناوری اطلاعات برای آنالیز الگوی راه رفتن در حوزه بیماری آلزایمر از جنبه‌های مختلف مانند رابطه میان راه رفتن و بیماری آلزایمر، ابزارها و سنسورهای قابل استفاده، الگوریتم‌های آنالیز داده‌ها با روش‌های مبتنی بر آمار توصیفی و یادگیری ماشین و ... به‌طور جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطالعه تمرکز اصلی بر ابزارهایی است که بتوانند به تشخیص بیماری آلزایمر و تفکیک گروه‌های مختلف سالم، MCI و AD بپردازند.

در این مقاله مروری، در ابتدا پس از بیان مقدمه، روش مطالعه برای یافتن مقالات و پژوهش‌های مرتبط با موضوع بررسی خواهد شد. سپس در بخش الگوی راه رفتن و آلزایمر، ارتباط میان راه رفتن و بیماری آلزایمر در افراد سالم‌مند بررسی می‌شود. در بخش‌های بعدی مطالعات پیشین از نظر نوع سنسورها، ویژگی‌های استخراجی از راه رفتن برای تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر و روش‌های آنالیز مطالعات پیشین بررسی می‌شود. در بخش آخر نیز در قسمت بحث و نتیجه‌گیری مرور کلی بر یافته‌های پیشین، چالش‌ها و چشم‌انداز مطالعات آینده خواهد شد.

مواد و روش‌ها

مقاله حاضر یک مقاله مروری است که به بررسی پژوهش‌های پیشین که در زمینه شناسایی بیماری آلزایمر با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن افراد سالم‌مند با کمک ابزارهای نوین حوزه فناوری اطلاعات انجام شده است، می‌پردازد.

روش‌های نوین غیر تهاجمی، سریع و کم‌هزینه برای شناسایی و ارزیابی بیماری آلزایمر پیشنهاد شده است. همان‌طور که در فوق اشاره شد، بیماری آلزایمر و سایر انواع دمанс عوموماً به عنوان یک اختلال شناختی برجسته در نظر گرفته می‌شود، ولی در کنار کاهش توانایی شناختی فرد، شواهد موجود بر اساس مطالعات پیشین انجام شده نشان می‌دهد که اختلالات الگوی راه رفتن نیز در مراحل اولیه این بیماری دیده می‌شود. این اختلالات الگوی راه رفتن می‌تواند شامل کاهش سرعت راه رفتن، طول گام، فرکانس گام، و همچنین افزایش تغییرپذی الگوی راه رفتن افراد باشد. علاوه بر ارتباط میان اختلالات شناختی با الگوی راه رفتن، اختلالات کارکردی افراد با کاهش سرعت راه رفتن، افزایش تغییرپذیری چرخه راه رفتن (Gait Cycle Variability)، افزایش زمین‌خوردن فرد و همچنین کاهش توانایی فرد در انجام فعالیت‌های پیچیده حرکتی ارتباط دارد [۵]. حتی بررسی‌های پیشین انجام شده نشان می‌دهد که در انجام فعالیت راه رفتن دوگانه (Dual task walking) که همراه با یک فعالیت ذهنی مانند شمارش اعداد است، اختلالات در افراد سالم‌مند نسبت به افراد جوان، افراد با سابقه زمین‌خوردن نسبت به افرادی که زمین نخورده‌اند و همچنین افراد با اختلالات شناختی نسبت به افراد سالم بدون اختلالات شناختی بیشتر بوده است. مطالعات مبتنی بر تصویربرداری مغزی نیز شواهد نزولوژیکی را برای ارتباط میان الگوی راه رفتن و وضعیت شناختی افراد در مطالعات پیشین نشان داده است. در مطالعه انجام شده توسط Maluin و همکاران که به‌وسیله تصویربرداری با دستگاه PET از مغز افراد مورد مطالعه انجام شده بود، حکایت از افزایش فعالیت در بخش‌های مغزی مرتبط با سطوح بالایی قشر مغز مانند ناحیه هیپوکامپال، که از نظر کارکردی با بخش‌هایی مرتبط است که ناحیه بسیار مهمی برای توانایی‌های کارکردی و حرکتی فرد هستند، با فعالیت راه رفتن و سایر فعالیت‌های فیزیکی روزانه در افراد سالم‌مند دارد. این نواحی مرتبط با توانایی‌های کارکردی از جمله نواحی مغزی هستند که در نتیجه بیماری آلزایمر و سایر انواع دماس تحت تأثیر قرار می‌گیرند [۶]. علاوه بر این در مطالعه دیگری که توسط Nakamura و همکارانش انجام شد، نتایج به‌دست آمده نشان داد که میان کاهش جریان خون در نواحی خاصی از مغز در مدت زمان معین و کاهش تغییرپذیری طول گام در افراد با بیماری آلزایمر ارتباط وجود دارد [۷].

با توجه به یافته‌های مطالعات پیشین که نشان می‌دهد که میان توانایی شناختی و اختلالات الگوی راه رفتن ارتباط مستقیم وجود دارد، توجه ویژه‌ای به مطالعه بر روی گروه‌های سالم‌مند با اختلالات شناختی خفیف (Mild Cognitive Impairment, MCI) انجام شد.

اختلالات شناختی در افراد به خاطر بیماری‌های مانند بیماری آلزایمر باشد [۳۷]. فرآیند راه رفتن ترکیبی از یک مجموعه سلسله مراتبی ساخته شده از چرخه راه رفتن (Gait Cycle (Stride)) است. یک چرخه راه رفتن برای یک پا از زمین شامل برخورد متواالی پاشنه یک پا با زمین تعریف می‌شود. شکل ۱ به طور نمونه مراحل مختلف برای تولید یک چرخه راه رفتن نرمال را نشان می‌دهد [۳۸]. هر چرخه راه رفتن از دو بخش (فاز اصلی) ایستادن و تغییر حالت (چرخش) ساخته می‌شود. همان‌طور که در شکل ۱ دیده می‌شود، بخش‌های مختلفی از اندام‌های فرد در شکل‌گیری این چرخه راه رفتن نقش دارند. بنابراین در صورت بروز اختلالات شناختی، عملکرد این بخش‌های مختلف ممکن است چهار تغییرات شوند [۳۷]. مطالعات مختلف انجام شده نشان می‌دهد که تغییرات در الگوی راه رفتن می‌تواند به عنوان ویژگی‌هایی برای تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر و طبقه‌بندی افراد سالم و گروه‌های با بیماری افراد سالم‌مند استفاده شود [۱۰، ۱۱، ۲۲، ۳۷، ۳۹].

در سال‌های اخیر، تحقیقات بر روی یافتن نشانگرهای مختلف در راه رفتن برای افراد با بیماری آلزایمر در مراحل اولیه بیماری افزایش یافته و توجه‌ای ویژه به رابطه بین سیستم کارکردن افراد مانند فعالیت راه رفتن با بیماری آلزایمر و سایر انواع دماسن شده است [۳۱]. به طور مثال مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که به طور کلی افراد با بیماری آلزایمر نسبت به افراد سالم بسیار آرام‌تر قدم برداشته و احتمال زمین خوردن نیز در آن‌ها بیشتر است. هم‌چنین اختلالات در الگوی راه رفتن افراد بیمار در مراحل اولیه بیماری نیز مشاهد شده و به عنوان یک نشانگر فرآیند پیشرفته بیماری از مرحله MCI به مرحله AD است. مطالعه الگوی راه رفتن برای ارزیابی بیماری آلزایمر، به صورت تست‌های راه رفتن یگانه (Single task walking) و راه رفتن دوگانه با یک فعالیت ذهنی صورت می‌گیرد. در تست‌های دوگانه در مقایسه با تست‌های یگانه، ضمن راه رفتن فرد، از فرد خواسته می‌شود تا یک فعالیت ذهنی مانند شمارش معکوس اعداد نیز انجام دهد. در این شرایط، تأثیر سیستم حواس بر روی عملکرد فرد بهتر قابل ارزیابی است [۴۰]. افراد با شرایط MCI و AD در هنگام انجام تست دو فعالیته، معمولاً اختلالات قوی‌تر و علائم برجسته‌تری را نسبت به حالت تک فعالیته در الگوی راه رفتن خود نشان می‌دهند. فعالیت‌های مختلف ذهنی به عنوان فعالیت دوم معمولاً در تست‌ها استفاده می‌شود. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به شمردن برعکس، تست روانی کلام (گفتار) (Verbal fluency) یا خواندن حروف متناوب الفبا (Reciting alternate letters of the alphabet) اشاره کرد. این تست‌های دوگانه به طور کلی

یافته‌های این مقاله بر اساس پژوهش‌های منتشر شده در پایگاه‌های اطلاعاتی IEEE, Google Scholar, Springer و Elsevier است. از کلمات کلیدی Mild Cognitive Impairment (MCI), Gait, Walking, Alzheimer, Diagnose, Detection, Impairment است. ترکیب‌های مختلف و بر اساس جستجو در عنوان، چکیده و کلمات کلیدی پژوهش‌های منتشر شده به صورت مقالات زورنال و کنفرانس برای یافتن پژوهش‌های پیشین استفاده شده است. تنها از مقالاتی که پژوهشی بوده‌اند برای بررسی مقاله حاضر استفاده شده است و مقالاتی که به صورت مروجی بوده‌اند، از مقاله مروجی حاضر حذف شده‌اند. هم‌چنین پس از دست‌یابی به پژوهش‌های پیشین، تنها مقالاتی که با هدف شناسایی بیماری آلزایمر با استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی مانند انواع سنسورها به آنالیز الگوی راه رفتن برداخته بودند، برای بررسی نهایی انتخاب شده‌اند. هم‌چنین مقالاتی که با اهداف دیگری غیر از شناسایی بیماری آلزایمر مانند اهداف توان‌بخشی و ... در افراد با بیماری آلزایمر نیز انجام شده بودند، از پژوهش حاضر حذف شده‌اند. به طور کلی پس از انجام جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی اشاره شده در فوق و اعمال معیارهای لازم برای انتخاب مقالات واجد شرایط برای پژوهش مروجی حاضر، تعداد ۲۶ مقاله انتخاب شدند. به طور کلی بررسی مقالات انتخابی نشان داد که این مقالات در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ انجام شده بودند. جدول (۱) مقالات انتخابی برای پژوهش مروجی حاضر را که پس از فیلتر کردن مقالات پیشین بر اساس معیارهای اشاره شده در فوق انجام شده بود، نشان می‌دهد. این جدول در کنار هدف کلی مطالعات پیشین، نوع ابزار استفاده شده برای ثبت تست‌های راه رفتن را به همراه نوع تست راه رفتن استفاده شده برای هر مطالعه بیان می‌کند.

بررسی ارتباط الگوی راه رفتن و بیماری آلزایمر برخلاف تعریف ساده "Gait" به عنوان یک روش راه رفتن، این الگوی راه رفتن ویژگی‌های خاصی از ساختار بدنی و فیزیولوژیکی شخص هستند که با توجه به عملکرد بخش‌های مختلف مغزی و فیزیکی بدن شخص و با توجه به عواملی مانند سن، بیماری، وزن شخص، طول اندام‌ها، وسیله پوشیده شده برای پا (کفش) و وضعیت حرکات بخش‌های مختلف بدن در افراد تغییر می‌کند [۳۶]. بنابراین راه رفتن شامل عملکرد بخش‌های مختلفی از سیستم حرکتی مانند موقعیت‌شناسی، توجه و برنامه‌ریزی در انجام فعالیت‌ها و حرکت شخص است. نقص در این بخش‌ها از سیستم می‌تواند منجر به اختلال و تغییرات در عملکردهای حرکتی فرد و تغییر الگوی راه رفتن آن‌ها از حالت نرمال شود که این تغییرات می‌تواند نشانگرهایی برای وجود

بر روی اندام فرد) هستند. اگر چه سنسورهای بینایی راه حل مناسب و عملیاتی تری را برای ثبت راه رفتن افراد نسبت به سایر روش‌های مبتنی بر سنسورهای غیربینایی پوشیدنی مانند شتاب‌سنج‌ها و ... فراهم می‌کنند، اما عمدۀ مطالعات و روش‌های تحلیل راه رفتن با استفاده از سنسورهای پوشیدنی غیربینایی انجام شده است. زیرا سنسورهای غیربینایی اطلاعاتی را به طور مستقیم از تغییرات در مفاصل فرد برای آنالیز راه رفتن ارائه می‌دهند [۴۳]. شکل ۲-ب نمونه‌ای از یک سیستم ثبت راه رفتن با کمک دوربین پوشیدنی که بر روی کفش فرد هنگام راه رفتن نصب شده و توسط D0 و همکاران ساخته شده است را نشان می‌دهد [۴۴]. این سیستم با ثبت محل برخورد پا با سطح زمین به کمک تصاویر ثبت شده به‌وسیله دوربین نصب شده بر روی کفش فرد، ویژگی‌های مختلفی از راه رفتن مانند طول گام و ... را با کمک تعیین محل برخورد به‌وسیله نوار درجه‌بندی شده بر روی سطح زمین تعیین می‌کنند.

همان‌طور که در فوق اشاره شد، دسته دوم سیستم‌های ضبط و تحلیل الگوی راه رفتن مبتنی بر سنسورهای غیرپوشیدنی است. این سیستم‌ها به دو دسته کلی سنسورهای نصب در کف و سیستم‌های مبتنی بر پردازش تصویر با نصب دوربین در محل تقسیم می‌شوند. در سیستم‌های مبتنی بر سنسورهای نصب در کف، شبکه‌ای از سنسورها بر روی یک مسیر مشخص و محدود به صورت یک نوار برای راه رفتن نصب شده و به هنگام گام برداشتن شخص بر روی این نوار سنسوری، پارامترهای مختلف الگوی راه رفتن مانند فاصله گام‌ها، زمان لازم برای طی مسافت، سرعت قدم برداشتن و ... با توجه به حس شدن فشار کف پای افراد به‌وسیله سنسورها، محاسبه می‌شود. شکل ۳ نمونه‌ای از این سیستم ثبت الگوی راه رفتن به‌وسیله سیستم GaitRite شناخته می‌شود، شده در کف زمین که به عنوان سیستم شامل شبکه‌ای از سنسورهای را نشان می‌دهد. این سیستم شامل شبکه‌ای از سنسورهای فشارسنج است که در کف زمین برای یک مسیر مشخص با طول محدود نصب شده و محل برخورد پا با سطح زمین را درنتیجه فعال شدن این سنسورها تعیین می‌کند. هم‌چنین با کمک دوربین فرآیند انجام فعالیت برای آنالیزهای بعدی ثبت می‌شود. اطلاعات مربوط به فعال شدن شبکه سنسورها به کامپیوترهایی متصل به این شبکه سنسورها، برای پردازش‌هایی با نرم‌افزارهای مربوطه برای تعیین ویژگی‌هایی مانند طول گام، طول چرخه راه رفتن و ... منتقل می‌شود [۴۵]. نوع دوم سیستم‌های غیرپوشیدنی مانیتورینگ و تحلیل راه رفتن افراد، مبتنی بر سیستم‌های تصویربرداری و پردازش تصویر با استفاده از دوربین‌های نصب شده در محیط است. سیستم‌های آنالیز راه رفتن غیرپوشیدنی مبتنی بر پردازش تصویر را می‌توان به دو دسته دوربین‌های

منجر به افزایش تلاش در سیستم فعالیت دو منظوره با توجه به فشار ذهنی بیش تر افراد مورد آزمایش شده و حساسیت ارزیابی الگوی راه رفتن را افزایش می‌دهند. با توجه به سالمند بودن افراد تست شمارش معکوس اعداد معمولاً مناسب‌تر از سایر انواع فعالیت‌های ذهنی دوم است [۱۴، ۲۶، ۳۱]. بررسی مطالعات طولانی مدت بر روی گروه‌های مختلف با بیماری آلزایمر نشان می‌دهد که افراد با بیماری آلزایمر و سایر انواع دمانت از نظر شناختی و کارکردی در دوره طولانی مدت دچار کاهش و ضعف در کارکرد می‌شوند. راه رفتن افراد با سرعت متوسط و معمولی نیز به عنوان یک عملکرد فیزیکی تحت تأثیر تغییرات کاهنده شناختی در درازمدت قرار گرفته و کاهش می‌یابد. بنابراین تغییرات سرعت می‌تواند به عنوان یک نشانگر قوی برای کاهش وضعیت شناختی افراد در طی زمان نیز باشد [۲۹، ۳۰].

ابزارها و سنسورهای ثبت راه رفتن

یکی از مسائل مهم در مطالعات انجام شده در شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر و تکییک گروه‌های مختلف سالم و بیمار از هم به کمک آنالیز راه رفتن، سنسورها و ابزارهای سخت‌افزاری برای ثبت اطلاعات راه رفتن و سایر فعالیت‌های فیزیکی افراد مورد مطالعه است. علاوه بر روش‌ها و الگوریتم‌های پردازش داده‌ها، سخت‌افزار و سنسورهای نیز در شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر با استفاده از الگوی راه رفتن افراد سالم‌ند نقش ویژه‌ای دارند. به‌طور کلی انواع سیستم‌های ثبت الگوی راه رفتن را می‌توان به دو دسته کلی سنسورهای پوشیدنی (نصب بر روی بدن) و سنسورهای غیرپوشیدنی (نصب در محیط) تقسیم کرد [۴۱، ۴۲].

در روش‌های آنالیز راه رفتن با استفاده از سنسورهای پوشیدنی، سنسورهای حرکتی بر روی بخش‌های مختلف بدن بیمار مانند پاها، مج پا، مفاصل ران و ... نصب می‌شوند. این سنسورها ممکن است از نوع شتاب‌سنج، زاویه‌سنج، سنسورهای فشار، جهت‌سنج و ... باشند که می‌توانند ویژگی‌های مختلف الگوی راه رفتن فرد را اندازه‌گیری کنند. برای اندازه‌گیری دقیق و کامل ویژگی‌های راه رفتن معمولاً از سیستم‌های مرکب از چند نوع سنسور پوشیدنی استفاده می‌شود [۴۱، ۴۲]. شکل ۲-الف نمونه‌ای از سنسور پوشیدنی که بر روی بدن فرد نصب شده را نشان می‌دهد. این سیستم ثبت راه رفتن شامل سنسورهای شتاب‌سنج و ژیروسکوپ است که اطلاعات راه رفتن مربوط به اندام‌های پا را با توجه به تغییرات شتاب و زاویه آن‌ها در هنگام فرآیند راه رفتن به صورت سیگنال ثبت کرده و در یک حافظه داخلی ذخیره می‌کنند. نوع دیگری از سنسورهای پوشیدنی که در سال‌های اخیر به دلیل تمرکز بر روی بخش خاصی از اندام‌ها، مورد توجه قرار گرفته است، دوربین‌های پوشیدنی (نصب شده

همه فعالیت‌های انسانی قابل شناسایی هستند. به همین دلیل در سیستم‌های تحلیل الگوی راه رفتن جدید، از دوربین‌های عمقی کینکت با قابلیت تفکیک بالا و دارای اطلاعات مختلف مانند تصاویر رنگی، تصاویر عمق و تصاویر اسکلتی استفاده می‌شود [۴۳، ۴۷]. شکل ۴ نمونه‌ای از یک سیستم ثبت راه رفتن به‌وسیله دوربین کینکت به همراه انواع تصاویر به دست آمده به‌وسیله این نوع دوربین‌ها را نشان می‌دهد. این سیستم ثبت با استفاده از یک نوع دوربین عمق مانند دوربین کینکت که توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است، در کنار تصاویر رنگی، تصاویر عمق را که تصاویری با رنگ مختلف هستند و تغییرات رنگ با توجه به فاصله افراد و اشیاء از دوربین تغییر می‌کند و هم‌چنین تصاویری از مفاصل بدن فرد که به عنوان تصاویر اسکلتی شناخته می‌شود، می‌تواند تولید کند. در جدول ۱ به‌طور خلاصه مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع راه رفتن و هم‌چنین انواع سخت‌افزارهایی که در مطالعات پیشین که برای شناسایی زودهنگام و ارزیابی بیماری آلزایمر استفاده شده بود، جهت مقایسه و بررسی آورده شده است.

رنگی (RGB) و سیستم‌های تصویربرداری عمق (RGBD) تقسیم کرد. در سیستم‌های پردازش تصویر با روش دوربین‌های غیرپوششی (نصب دوربین در محیط)، مانند سیستم‌های دوربین RGB، با نصب یک یا چند دوربین در یک مکان مشخص می‌توان به‌طور آزادانه و بدون وجود محدودیت بر روی بدن فرد، راه رفتن فرد را ثبت کرده و سپس تصاویر ضبط شده به‌وسیله سیستم‌های پردازش تصویر آنالیز شوند [۴۲، ۴۶]. دسته دوم سیستم‌های ثبت و تحلیل راه رفتن افراد مبتنی بر بینایی ماشین، با استفاده از دوربین‌های عمق (RGBD) انجام می‌شود. یکی از انواع دوربین‌های عمقی که در مطالعات مختلفی مانند بازشناسی افراد، آنالیز الگوی راه رفتن و فعالیت‌های فیزیکی و ... استفاده می‌شود، تحت عنوان دوربین‌های کینکت (Kinect) توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است. دست‌یابی به تصاویر سه‌بعدی با استفاده از سنسورهای عمق، نسبت به تخمین تصاویر سه‌بعدی با استفاده از چند دوربین معمولی، به مراتب راحت‌تر است. هم‌چنین سنسورهای عمق برخلاف سنسورهای معمولی ضبط تصویر، تحت تأثیر عوامل محیطی مانند نورپردازی محیط قرار نمی‌گیرند. هم‌چنین با تعداد فریم کم‌تری حدود ۱۵ فریم در ثانیه نیز تقریباً


جدول ۱. مطالعات انتخاب شده از میان مطالعات پیشین برای پژوهش مروری حاضر که بر اساس فیلترهایی مانند مطالعاتی که به شناسایی و ارزیابی بیماری آلزایمر با استفاده از فناوری سنسورها و روش‌های آنالیز آمار توصیفی و هوش مصنوعی پرداخته‌اند، انتخاب شده‌اند. این جدول مطالعات پیشین انتخابی را از نظر هدف کلی مطالعه، جمعیت-شناختی، نوع تست و ابزار مورد استفاده برای ثبت راه رفتن برای مقایسه نشان می‌دهد.

نویسنده‌گان	مرجع	هدف کلی مطالعه	جمعیت مطالعه						ابزار و سنسورهای ثبت	نوع تست راه رفتن
			سالم	خفیف	دماں	آلزایمر	سایر	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و حداقل		
[۹] Webster et al	بررسی تغییرات در الگوی راه رفتن افراد با بیماری آلزایمر	بررسی تغییرات در الگوی راه رفتن افراد با سرعت معمولی و حداقل	-	۱۰	-	۱۰	۱۰	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و حداقل	GaitRite	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و حداقل
[۱۰] Merory et al	بررسی تفاوت در الگوی راه رفتن افراد مبتلا به آلزایمر و دماں DBL	بررسی تفاوت در الگوی راه رفتن افراد مبتلا به آلزایمر و دماں DBL	۱۰	۱۰	-	۱۰	۱۰	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی	GaitRite	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی
[۱۱] Beauchet et al	بررسی تغییرات الگوی راه رفتن در راه رفتن با MCI سرعت بالا به عنوان نشانگر افراد با MCI	بررسی تغییرات الگوی راه رفتن در راه رفتن با سرعت بالا به عنوان نشانگر افراد با MCI	۴۴	۳۹	۳۳	-	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و حداقل سرعت	GaitRite	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و حداقل سرعت
[۱۲] Ries et al	بررسی قابلیت اعتماد و تکرارپذیری تست‌های مختلف راه رفتن برای افراد با بیماری آلزایمر با شدت بیماری متفاوت	بررسی قابلیت اعتماد و تکرارپذیری تست‌های مختلف راه رفتن برای افراد با بیماری آلزایمر با شدت بیماری متفاوت	-	-	-	-	-	راه رفتن تک فعالیته با حداقل سرعت و تست TUG	GaitRite, Watch	راه رفتن تک فعالیته با حداقل سرعت و تست TUG
[۱۳] Gillain et al	بررسی سیستم اندازه‌گیری Locometrix برای آنالیز راه رفتن افراد با بیماری آلزایمر و مقایسه قابلیت آن با تست‌های کلینیکی	بررسی سیستم اندازه‌گیری Locometrix برای آنالیز راه رفتن افراد با بیماری آلزایمر و مقایسه قابلیت آن با تست‌های کلینیکی	۱۴	۱۴	۶	-	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و حداقل سرعت و راه رفتن دونفعالیته با سرعت معمولی و حداقل به همراه شمارش معکوس اعداد	Accelerometer	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و حداقل سرعت و راه رفتن دونفعالیته با سرعت معمولی و حداقل به همراه شمارش معکوس اعداد
[۱۴] Maquet et al	طبقه‌بندی افراد سالم، MCI و AD بر اساس ویژگی‌های تست‌های یگانه و دوگانه راه رفتن و مقایسه نتایج حاصل از تست‌ها	طبقه‌بندی افراد سالم، MCI و AD بر اساس ویژگی‌های تست‌های یگانه و دوگانه راه رفتن و مقایسه نتایج حاصل از تست‌ها	۱۴	۱۴	۶	-	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دونفعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دونفعالیته با سرعت معمولی	Accelerometer	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دونفعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دونفعالیته با سرعت معمولی
[۱۵] Choi et al	مقایسه الگوی راه رفتن در افراد AD, MCI و NC برای تست طولانی ۲۵ متر و با سرعت معمولی	مقایسه الگوی راه رفتن در افراد AD, MCI و NC برای تست طولانی ۲۵ متر و با سرعت معمولی	۶	۷	۱۰	-	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی	Accelerometer	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی


نوبنده‌گان	مرجع	هدف کلی مطالعه	اخلالات	جمعیت مطالعه		نوع تست راه رفتن	ابزار و سنسورهای ثبت	
		سالم	خفیف	آلزایمر	سایر	دمنس		
[۱۶]	Muir et al	طبقه‌بندی افراد سالم، MCI و AD بر اساس ویژگی‌های تست‌های یگانه و سه نوع تست دوگانه مختلف راه رفتن و مقایسه نتایج	۲۹	۲۳	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه شمارش معکوس اعداد و نام بردن حیوانات	GaitRite	
[۱۷]	Chung et al	آنالیز الگوی راه رفتن افراد سالم‌بند بوسیله سنسور شتاب‌سنج سه محوره به منظور شناسایی بیماری آلزایمر	-	۹	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه شمارش معکوس اعداد	Accelerometer	
[۱۸]	Cedervall et al	مطالعه طولانی مدت (دوساله) تغییرات الگوی راه رفتن برای افراد مبتلا به MCI	-	۲۱	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه نام بردن حیوانات	Optical sensor	
[۱۹]	Boripuntakul et al	بررسی تغییرات ویژگی‌های زمان- مکانی در بخش اولیه رفایند راه رفتن در افراد با اختلالات شناختی ملایم (MCI) در فعالیت یگانه و دوگانه راه رفتن با فعالیت ذهنی	۳۰	۳۰	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه شمارش معکوس اعداد	GaitRite	
[۲۰]	Wang et al	تفکیک افراد سالم و افراد با بیماری آلزایمر بوسیله آنالیز راه رفتن به کمک سنسورهای پوشیدنی	-	۳۰	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه شمارش معکوس اعداد	Gyroscope, Accelerometer	
[۲۱]	Hsu et al	آنالیز تعادل و راه رفتن بوسیله سنسورهای پوشیدنی برای تفکیک افراد سالم و بیمار	-	۲۱	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه شمارش معکوس اعداد	Gyroscope	
[۲۲]	Gras et al	مقایسه عملکرد افراد سالم، MCI و AD در تست‌های مختلف راه رفتن یگانه با شرایط مختلف راه رفتن	-	۱۳	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و حداکثر سرعت و تست	GaitRite	
[۲۳]	Akl et al	تخمین نمودار توزیع سرعت راه رفتن افراد در طول روز در خانه برای شناسایی افراد MCI	-	۱۸	۷۹	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی	Motion sensors on ceiling	
[۲۴]	Gillain et al	بررسی سرعت راه رفتن و تغییرات در راه رفتن به عنوان نشانگرهایی برای خطر ابتلا به آلزایمر برای افراد با MCI	-	۹	۴	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه شمارش معکوس اعداد	Accelerometer	
[۲۵]	Wang et al	مقایسه مدل راه رفتن در حالت تک فعالیته و دوفعالیته برای افراد سالم و افراد با بیماری آلزایمر بوسیله مدل‌سازی الگوی راه رفتن با مدل مخفی مارکوف	-	۴۲	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه شمارش معکوس اعداد	Gyroscope, Accelerometer	
[۲۶]	Rucco et al	استخراج ویژگی‌های مختلف کینماتیک و ویژگی‌های زمان- مکان از تصاویر ثبت شده با دوربین‌های مادون قرمز از راه رفتن افراد در تست‌های یگانه و دوگانه و مقایسه نتایج با هم	۲۳	۲۲	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه شمارش معکوس اعداد	Camera	
[۲۷]	Borges et al	بررسی ارتباط میان جابجایی کارکردی (راه رفتن) و عملکرد شناختی در افراد سالم‌بند با اختلالات شناختی بوسیله تست‌های TUG ساده و TUG همراه با فعالیت ذهنی	-	۲۶	۴۲	۳۶	تست TUG تک‌فعالیته و دوفعالیته همراه با فعالیت ذهنی	Watch
[۲۸]	Montero-Odasso et al	مطالعه طولانی مدت شش ساله تغییرات ویژگی- های مکان- زمانی الگوی راه رفتن و فرآیند تغییرات شدت بیماری افراد MCI	-	-	۱۱۲	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه شمارش معکوس اعداد و نام بردن حیوانات	GaitRite	

نوبیندگان	مرجع	هدف کلی مطالعه	جمعیت مطالعه					
			سالم	اختلالات	آلزایمر	سایر	نوع تست راه رفتن	ابزار و سنسورهای ثبت
Taylor et al	[۲۹]	بررسی تغییرات در سرعت راه رفتن افراد با تغییر وضعیت شناختی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر در یک دوره یکساله	-	-	-	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و تست TUG	Watch
MacAulay et al	[۳۰]	مقایسه راه رفتن افراد سالم و MCI در طول یک مسیر آزاد در راهرو در تست‌های یگانه و دوگانه	۲۷	۳۴	-	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه هجای بر عکس یک کلمه	Watch
König et al	[۳۱]	استفاده از سیستم شتاب‌سنج نصبی بر روی بیمار به منظور مقایسه الگوی راه رفتن افراد سالم، AD و MCI و تفکیک آنها	۲۲	۲۴	۲۳	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی و راه رفتن دوفعالیته با سرعت معمولی به همراه شمارش معکوس اعداد	Accelerometer
Varatharajan	[۳۲]	طبقه‌بندی افراد سالم و AD با روش DTW و تست‌های یگانه و تبدیل داده‌ها به سری زمانی	۱۵۰	-	۱۷۳	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی	Accelerometer
Callisaya et al	[۳۳]	بررسی ارتباط میان سرعت راه رفتن در حالت راه رفتن با سرعت دلخواه، راه رفتن با حداکثر سرعت و ویژگی اختلاف میان سرعت‌های دلخواه و حداکثر با وضعیت شناختی افراد سالم	۳۲۱	۲۵۲	۱۰۸	-	راه رفتن تک فعالیته با حداکثر سرعت	GaitRite
Hausdorff et al	[۳۴]	بررسی ارتباط میان مدت زمان و کیفیت الگوی راه رفتن افراد سالم‌ند با مرحله اختلالات شناختی MCI	۱۰۰	۳۶	-	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی	Accelerometer
Ardlea et al	[۳۵]	بررسی آنالیز راه رفتن در محیط‌های چندگانه کلینیکی و خانه افراد سالم‌ند به منظور شناسایی بیماری آلزایمر	۵۵	-	۱۷	-	راه رفتن تک فعالیته با سرعت معمولی	Accelerometer

NC (No Cognitive Impairment), MCI (Mild Cognitive Impairment), AD (Alzheimer Disease), DLB (Dementia with Lewy Bodies), DTW (Dynamic Time Warping)

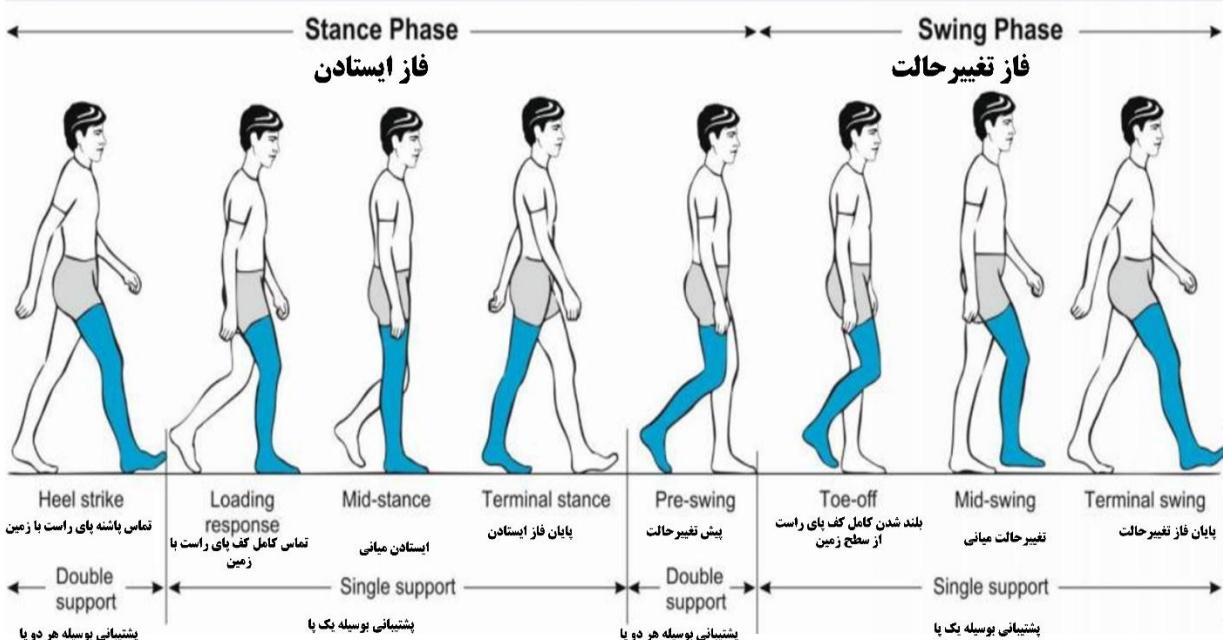


شکل ۱. مراحل مختلف چرخه راه رفتن که شامل دو فاز ایستادن و فاز تغیر حالت است. هر فاز خود شامل مراحل مختلفی با توجه به تغییر وضعیت پا در هنگام راه رفتن است [۳۸].

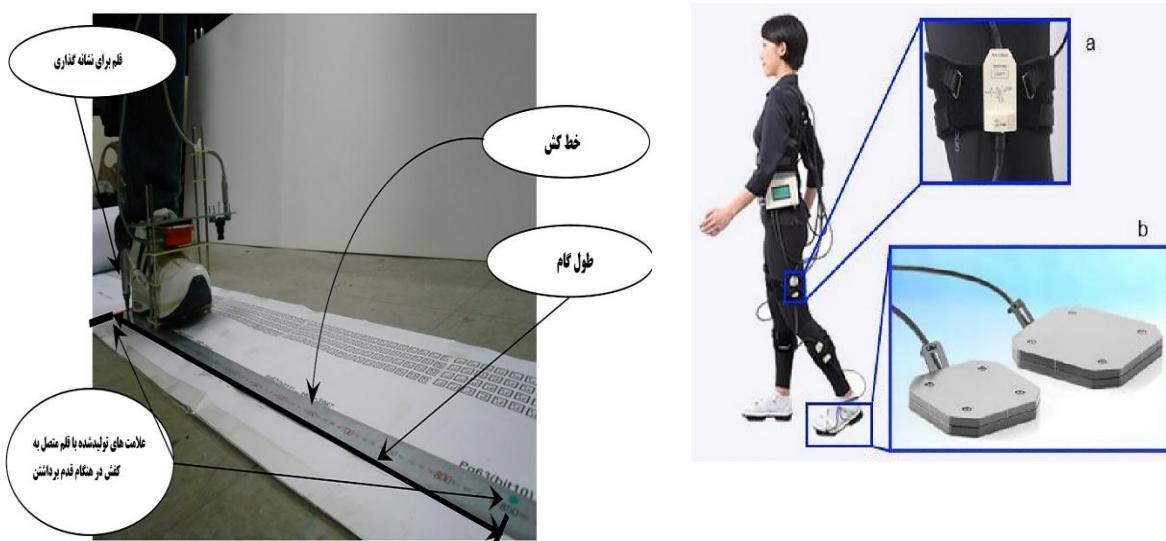


ب. سیستم ثبت راه رفتن به کمک دوربین‌های پوشیدنی که بر روی پای فرد نصب شده و با راه رفتن فرد بر روی یک مسیر درجه‌بندی شده، محل برخورد پای فرد با این مسیر تصویربرداری شده و با کمک آنالیزهای پردازش تصویر محل برخورد پا در تصاویر مشخص می‌شود [۴۴]

الف. سیستم ثبت راه رفتن با سنسورهای پوشیدنی که با نصب سنسورهای شتاب‌سنج و ژیروسکوپ بر روی بدن فرد، تغییرات پای فرد در هنگام راه رفتن را بصورت سیگنال ثبت کرده و سپس بصورت واپرس به یک کامپیوتر منتقل یا در یک حافظه داخلی ذخیره می‌شود [۴۲، ۴۱]

شکل ۲. نمونه‌هایی از سیستم‌های پوشیدنی ثبت راه رفتن که با استفاده از سنسورهای مختلف مانند سنسورهای شتاب‌سنج، ژیروسکوپ و دوربین‌های نصب بر روی بدن فرد به ثبت فعالیت راه رفتن فرد می‌پردازند.


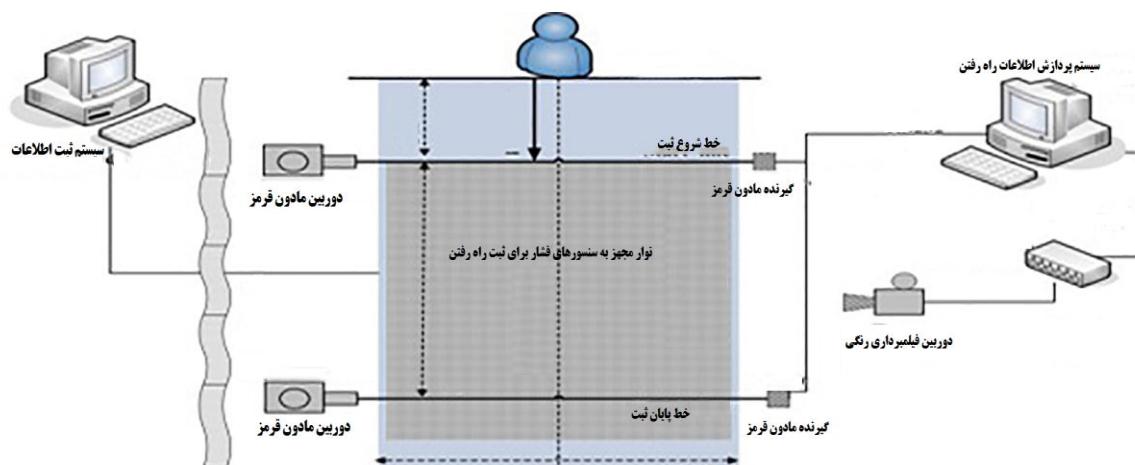


شکل ۳. سیستم GaitRite برای ثبت راه رفتن با کمک سنسورهای غیرپوشیدنی کف زمین که شامل یک مسیر مجهز به سنسورهای فشار‌سنج نصب شده در کف و همچنین دوربین‌هایی برای ثبت فعالیت راه رفتن و یک سیستم کامپیوترا برای انتقال اطلاعات ثبت شده به آن و پردازش آن‌ها می‌باشد [۴۵].

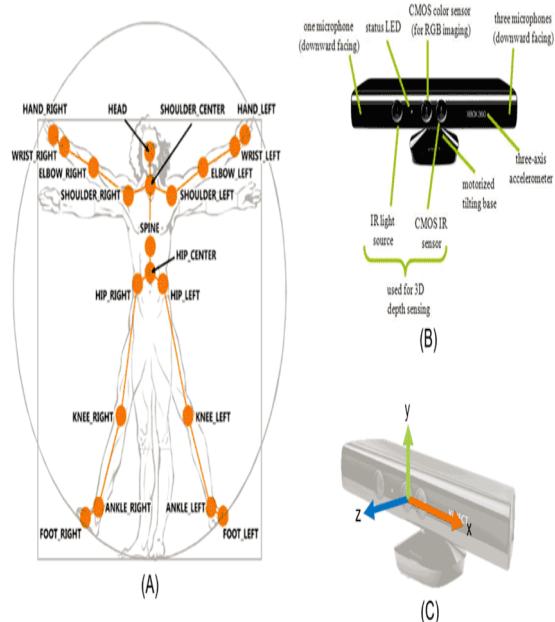

ب. تنظیمات دوربین کینکت در محیط برای ثبت که با توجه به محدودیتهای فاصله‌ای برای دوربین کینکت باید در فاصله‌ای قرار گیرد که قابلیت ضبط اسکلت و تصاویر عمق نیز در کل تصاویر رنگی فراهم باشد.

الف. دوربین کینکت به همراه نقاط اسکلتی قابل ثبت برای انسان که دارای بخش‌های مختلفی مانند سنسورهای رنگی برای ثبت تصاویر رنگی، سنسورهای مادون-قرمز برای تعیین عمق و ساخت تصاویر عمق و ساخت تصاویر اسکلتی که حدود ۲۰ نقطه بوسیله دوربین نسخه اول و حدود ۲۵ نقطه توسعه نسخه دوم از بدن انسان قابل ضبط است.

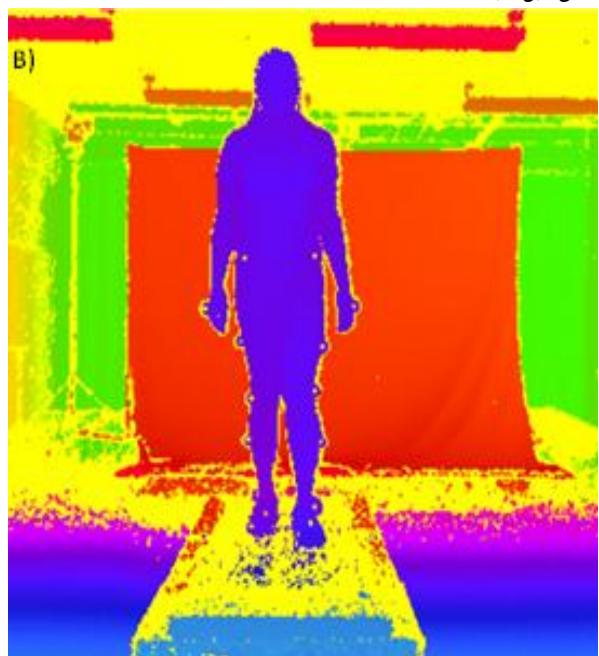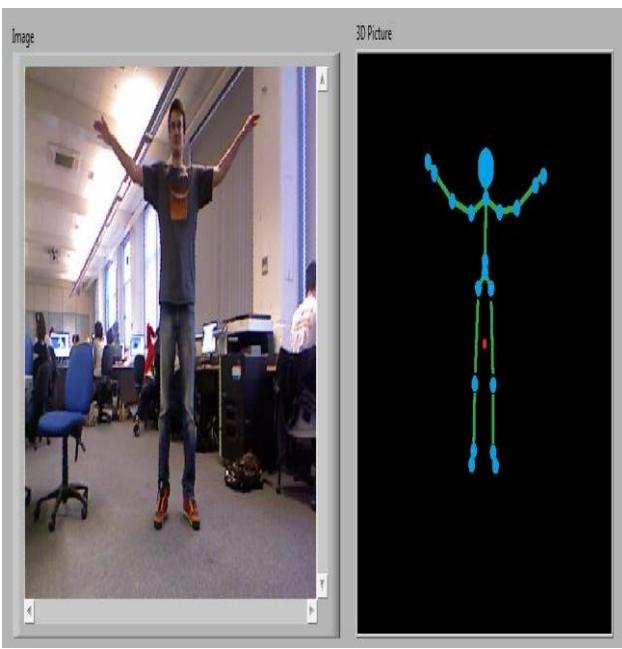

د. تصاویر اسکلتی و رنگی بدست آمده با دوربین کینکت که تصاویر اسکلتی شامل مفاصل مختلف از دوربین با رنگ‌های مختلف دیده می‌شوند.

ج. تصاویر عمق بدست آمده با دوربین کینکت که با توجه به فاصله فرد و اشیاء مختلف راه رفتن با استفاده از دوربین عمق کینکت شرکت مایکروسافت با قابلیت ضبط سه نوع داده تصاویر رنگی، تصاویر عمق و داده‌های اسکلتی از مفاصل بدن فرد.

رفتن گروه‌های مختلف سالمند سالم، MCI و بیمار AD نشان می‌دهد. یکی از بر جسته‌ترین و عمومی‌ترین ویژگی‌های مورد مطالعه میان گروه‌های مختلف مورد بررسی در پژوهش‌های پیشین، سرعت راه رفتن فرد است. بررسی سرعت راه رفتن در مطالعات پیشین در تست‌های متنوعی از راه رفتن مانند راه رفتن

نتایج

ویژگی‌های راه رفتن مرتبط با شناسایی زودهنگام و ارزیابی بیماری آلزایمر

بررسی نتایج حاصل از آنالیز الگوی راه رفتن در مطالعات پیشین، نتایج متنوعی را درباره ویژگی‌های استخراجی از راه

چرخه‌های پیاپی راه رفتن یک پا تعریف می‌شوند، در میان گروه‌های سالم و MCI و AD تفاوت دارند. تقارن چرخه در افراد سالم نسبت به افراد MCI و AD بیشتر است. اما میان گروه MCI و AD تفاوتی بر جسته دیده نشده است [۱۳، ۱۴]. اما برای ویژگی نظم چرخه راه رفتن، افراد با AD نسبت به افراد MCI و سالم کاهش زیادی دارد [۱۳]. بررسی ویژگی آماری استخراج شده ضرایب تغییرات برای زمان چرخه نیز برای گروه‌های مختلف مطالعه نتایج جالبی را به همراه دارد. اگر چه در راه رفتن با سرعت معمولی، ضرایب تغییرات زمان چرخه MCI و AD تفاوت بر جسته است [۱۱، ۱۵، ۱۶].

گام (step) دو میان بخش تشکیل‌دهنده فرآیند راه رفتن است که ویژگی‌های مانند طول گام، ارتفاع گام، ضرایب تغییرات طول گام و ... از آن برای بررسی ارتباط راه رفتن و بیماری آلزایمر محاسبه می‌شود. هر گام به فاصله بین برخود پاشنه پاهای راست و چپ در یک چرخه از راه رفتن گفته می‌شود. در واقع هر چرخه راه رفتن از دو گام پیاپی ساخته می‌شود. تعاریف ویژگی‌های طول، ارتفاع و ضرایب تغییرات برای گام مشابه تعریف این ویژگی‌ها در چرخه راه رفتن است با این تفاوت که در گام فاصله دو پای راست و چپ در هنگام برخورد پاشنه پا با کف زمین در یک چرخه در نظر گرفته می‌شود. بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که طول گام در افراد MCI نسبت به افراد سالم در هر دو حالت فعالیت یگانه و دوگانه راه رفتن کاهش می‌یابد [۱۸، ۱۹، ۲۲]. در مطالعات طولانی‌مدت که بر روی گروه‌های MCI و AD برای تغییرات الگوی راه رفتن صورت گرفته، نتایج حاصل نشان می‌دهد که ارتفاع گام‌ها تغییرات قابل توجهی در درازمدت ندارند [۱۸]. ویژگی‌های ضرایب تغییرات طول گام و عرض گام در افراد MCI نسبت به افراد سالم در هنگام راه رفتن کاهش می‌یابد [۱۹، ۳۱]. جدول مجموعه کاملی از ویژگی‌هایی که در مطالعات پیشین برای آزمون‌های راه رفتن برای ارزیابی بیماری آلزایمر در گروه‌های مختلف سالم‌مندان استفاده شده است را نشان می‌دهد. این جدول خلاصه‌ای از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که از الگوی راه رفتن برای شناسایی و ارزیابی بیماری آلزایمر در مطالعات پیشین استفاده شده به همراه یافته‌های این مطالعات درباره این ویژگی‌ها و ارتباط آن‌ها با بیماری آلزایمر و تغییراتی که برای این ویژگی‌ها در صورت وجود، رخداده بیان می‌کند.

۱۰ متری با سرعت دلخواه، با سرعت زیاد، آزمون TUG، راه رفتن دوگانه با شمارش معکوس اعداد، راه رفتن دوگانه با آزمون کلامی نام بردن اشیاء بر روی گروه‌های مختلف سالم، MCI و AD صورت گرفته است. نتایج کلی نشان می‌دهد که سرعت راه رفتن در گروه‌های بیمار با درجه مختلف بیماری نسبت به افراد سالم، کمتر است. اگر چه در راه رفتن تک فعالیته اختلاف بر جسته‌ای میان افراد سالم و افراد با MCI دیده نمی‌شود، ولی در فعالیت‌های دوگانه راه رفتن قابلیت تفکیک بین گروه‌های سالم، MCI و AD به مراتب با مقایسه سرعت راه رفتن بهتر مشهود است. در فعالیت‌های راه رفتن دوگانه به دلیل وجود یک فعالیت ذهنی به همراه راه رفتن، عملکرد شناختی افراد بر روی سیستم کنترل راه رفتن به‌طور بر جسته‌تری تأثیر گذاشته و منجر به کاهش سرعت راه رفتن در گروه‌های با MCI نیز می‌شود [۲۹، ۲۲، ۱۶، ۱۴، ۱۳].

چرخه راه رفتن که به عنوانین stride و Gait Cycle برای راه رفتن در انگلیسی شناخته می‌شود، از جمله بخش‌هایی از راه رفتن است که ویژگی‌های قابل توجهی از آن در مطالعات پیشین در حوزه آلزایمر استخراج شده است. فرآیند راه رفتن مجموعه‌ای از چرخه‌های متوالی است. یک چرخه کامل از فرآیند راه رفتن را از هنگام برخود پاشنه یک پا به کف زمین تا برخورد مجدد همان پاشنه پا با زمین تعریف می‌شود. در مطالعات آنالیز راه رفتن برای افراد سالم‌مند در حوزه آلزایمر بسیاری از ویژگی‌های استخراجی از یک چرخه راه رفتن نیز در فعالیت نشان می‌دهد که مدت زمان و طول چرخه راه رفتن نیز در فعالیت دوگانه نسبت به فعالیت یگانه در افراد با بیماری آلزایمر کاهش می‌یابد. همچنین تفاوت در چرخه راه رفتن در حالت دوگانه نسبت به راه رفتن یگانه در افراد AD و MCI نسبت به افراد سالم به‌طور محسوس‌تری دیده می‌شود [۱۶، ۱۵]. تفاوت در طول چرخه راه رفتن در افراد با MCI به خوبی نسبت به افراد سالم و AD دیده می‌شود [۲۶، ۱۴، ۱۳، ۱۰]. اما عرض یک چرخه راه رفتن که به صورت فاصله عرضی بین دو کف پا در یک چرخه راه رفتن تعریف می‌شود، بین گروه‌های مختلف سالم، MCI و AD تفاوتی که منجر به تفکیک این گروه‌ها از هم شود، دیده نمی‌شود [۲۶]. فرکанс چرخه راه رفتن (Stride Frequency) که به صورت تعداد چرخه‌های راه رفتن در یک زمان مشخص و برای یک فاصله معین تعریف می‌شود، در افراد با MCI نسبت به افراد سالم کاهش می‌یابد. در افراد با AD نیز در فعالیت دوگانه نسبت به فعالیت یگانه راه رفتن کاهش چشمگیرتری دارد [۱۳، ۱۴]. ویژگی‌های تقارن چرخه (Stride Symmetry) و نظم چرخه (Stride Regularity) که به ترتیب به صورت میزان تشابه بین چرخه پای راست و چپ و تشابه

تعیین این که فرد در چه مرحله‌ای از بیماری آزاریم قرار دارد را نیز انجام داد.

بررسی الگوریتم‌های آنالیز داده‌های راه رفتن در مطالعات پیشین آزاریم نشان می‌دهد که عمدۀ مطالعات پیشین از روش‌های مبتنی بر آمار توصیفی برای آنالیز داده‌ها استفاده نموده‌اند، اما در سال‌های اخیر مطالعات محدودی نیز از روش‌های متکی بر پردازش سیگنال و هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیشرفته‌تر شناسایی آماری الگو نیز برای ارزیابی‌های شناختی و کارکردی و نیز طبقه‌بندی گروه‌های مطالعه از نظر سلامت و شدت بیماری استفاده کرده‌اند. در مطالعات پیشینی که از سیگنال‌های ثبت شده به‌وسیله ژیروسکوپ و شتاب‌سنج بر روی بدن افراد برای ثبت راه رفتن استفاده شده است، از الگوریتم‌هایی مانند فیلترینگ، پنجه‌گذاری، آستانه‌گذاری برای یافتن چرخه راه رفتن و ... برای آنالیز داده‌های ثبت شده استفاده شده است. در این مطالعات هدف پردازش سیگنال‌های ثبت شده از راه رفتن افراد سالم‌نده به منظور استخراج ویژگی‌های مناسب برای استفاده در الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی به منظور تفکیک گروه‌های مختلف مطالعه از هم و همچنین تخمین امتیاز آزمون‌های کلینیکی است.

دسته سوم مطالعات از الگوریتم‌های مختلفی مانند الگوریتم‌های انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی مختلف مانند ماشین بردار پشتیبان، (DTW) Dynamic Time Warping، جنگل تصادفی و ... که از نوع الگوریتم‌های مبتنی بر شناسایی الگو و هوش مصنوعی هستند، با هدف تفکیک گروه‌های مختلف مطالعه از هم به‌وسیله انتخاب ویژگی‌های مناسب از میان ویژگی‌های استخراجی از آزمون راه رفتن افراد سالم‌نده استفاده کرده‌اند. در کنار طبقه‌بندی افراد از نظر بیماری سلامت به گروه‌های سالم، MCI و AD، تخمین امتیازات کلینیکی نیز می‌تواند به صورت هوشمند با کمک ویژگی‌های استخراجی از راه رفتن افراد به کمک این طبقه‌بندی‌ها صورت گیرد. به‌طور مثال Varatharajan و همکاران از الگوریتم DTW برای طبقه‌بندی و تفکیک گروه سالم و گروه افراد با بیماری آزاریم (AD) استفاده کرد [۳۲]. در این الگوریتم مجموعه‌ای از سیگنال‌های ثبت شده به‌وسیله سنسورهای نصبی بر روی بدن فرد در طی راه رفتن از افراد سالم و افراد AD به عنوان بردارهایی که درایه‌های آن به صورت سری‌های زمانی در طی راه رفتن برای یک محدوده مشخص تغییر می‌کنند در نظر گرفته می‌شود. سپس تغییرات در الگوی راه رفتن افراد با توجه به تغییراتی که در سری‌های زمانی بدست آمده در طی فرآیند راه رفتن افراد به وجود آمده است، به صورت یک سیگنال محاسبه می‌شود. با توجه به این که فرآیند تغییرات

الگوریتم‌های آنالیز داده‌های راه رفتن

پس از استخراج ویژگی‌های مختلف از الگوی راه رفتن افراد سالم‌نده، به منظور دستیابی به اطلاعات سودمندی درباره ارتباط میان این ویژگی‌های راه رفتن و شرایط شناختی افراد سالم‌نده از نظر بیماری آزاریم، تحلیل‌های آماری مختلف و تکنیک‌های آنالیز داده‌ها مانند بررسی میزان همبستگی و ویژگی‌های استخراج شده با نمرات حاصل از ارزیابی به کمک تست‌های کلینیکی، انجام می‌شود. به‌طور کلی انواع آنالیز‌های انجام شده بر روی الگوی راه رفتن به منظور ارزیابی شناختی و کارکردی افراد سالم‌نده و شناسایی زودهنگام بیماری آزاریم، شامل الگوریتم‌های مبتنی بر آمار توصیفی، الگوریتم‌های پردازش سیگنال و الگوریتم‌های مبتنی بر روش‌های هوش مصنوعی و شناسایی الگو است.

الگوریتم‌های آمار توصیفی با هدف کلی یافتن نشانگرهایی در راه رفتن برای شناسایی زودهنگام بیماری آزاریم صورت می‌گیرد. آنالیز‌هایی مانند میانگین، واریانس، همبستگی و ... از جمله آزمون‌های آمار توصیفی هستند که در مطالعات پیشین استفاده شده‌اند. آزمون آنالیز واریانس که در اکثر مطالعات انجام شده پیشین استفاده می‌شود، با هدف بررسی دامنه تغییرات ویژگی‌های مختلف استخراجی از راه رفتن افراد شرکت‌کننده در پژوهش، انجام می‌شود. با کمک آزمون T که به بررسی میانگین ویژگی‌ها در گروه‌های مختلف مطالعه می‌پردازد، می‌توان اختلاف میان گروه‌های مختلف و قابلیت تفکیک گروه‌های مطالعه را از نظر شدت بیماری از هم انجام داد. آزمون همبستگی نیز که از دیگر آنالیز‌های رایج و پرکاربرد است، میزان همبستگی بین ویژگی‌های استخراجی و ارزیابی‌های شناختی و کارکردی انجام شده به‌وسیله آزمون‌هایی مانند MoCa، MMSE و ... بر روی گروه‌های سالم، MCI و بیمار AD را بررسی می‌کند. ویژگی‌هایی که دارای همبستگی بالایی از نظر مقدار باشند، نشان‌دهنده ارتباط قوی میان آن‌ها و وضعیت شناختی و کارکردی افراد مورد مطالعه دارد. آنالیز رگرسیون نیز که در مطالعات پیشین همانند سه آزمون اشاره شده در فوق، به‌طور گسترده استفاده می‌شود، به جهت تخمین رابطه بین ویژگی‌ها و نمرات اکتسابی در آزمون‌های شناختی و کارکردی گروه‌های مورد مطالعه استفاده می‌شود. به کمک آنالیز رگرسیون می‌توان با یافتن یک رابطه خطی یا غیرخطی بین ویژگی استخراجی از راه رفتن و نمرات اکتسابی، به کمک آنالیز راه رفتن و استخراج مقادیر ویژگی راه رفتن فرد، نمرات آزمون‌های شناختی و عملکردی فرد را پیش‌بینی نمود. با کمک این پیش‌بینی انجام شده به‌وسیله آزمون رگرسیون می‌توان، طبقه‌بندی و تفکیک گروه‌های مورد مطالعه را از نظر سلامت و یا شدت بیماری و

می‌دهد. این آنالیزها شامل آنالیزهای مبتنی بر آمار توصیفی که با هدف یافتن ارتباط معنادار ویژگی‌های استخراجی از راه رفتن و بیماری آلزایمر در گروه‌های مورد مطالعه و همچنین آنالیزهای مبتنی بر هوش مصنوعی و شناسایی الگو که با هدف تفکیک هوشمند گروه‌های سالم و بیمار از هم بوده، نشان می‌دهد.

در الگوی راه رفتن افراد سالم و افراد AD متفاوت است، با مقایسه سیگنال‌های به دست آمده به کمک الگوریتم DTW، گروه‌های سالم و بیمار AD قابل تفکیک از هم هستند [۳۲]. جدول ۳ مجموعه‌ای از مهم‌ترین آنالیزهای انجام شده در مطالعات پیشین بر روی داده‌های ثبت شده از الگوی راه رفتن را در گروه‌های مختلف مطالعه در حوزه بیماری آلزایمر نشان

جدول ۲. مجموعه‌ای از ویژگی‌های بررسی شده برای الگوی راه رفتن در مطالعات پیشین با هدف شناسایی و ارزیابی بیماری آلزایمر و برخی از مهم‌ترین یافته‌ها برای این ویژگی‌ها بر اساس بررسی‌های انجام شده در مطالعات پیشین

نتایج و یافته‌ها	مراجع	فارسی	انگلیسی
- مدت زمان اتمام راه رفتن برای یک مسافت مشخص در افراد با بیماری آلزایمر نسبت به افراد سالم بیشتر است. - مدت زمان راه رفتن افراد با اختلالات شناختی خفیف نسبت به افراد سالم در طول روز کمتر است. - مدت زمان راه رفتن و انجام تست TUG نیز در افراد با اختلالات شناختی خفیف و افراد با بیماری آلزایمر نسبت به افراد سالم بیشتر است و با گذشت زمان بیشتر هم می‌شود.	[۱۲، ۱۷، ۲۲]	مدت زمان راه رفتن	Walking Time
- سرعت راه رفتن در افراد با بیماری آلزایمر و سایر انواع دماینس نسبت به افراد سالم و افراد با اختلالات شناختی خفیف کمتر است و با گذشت زمان نیز کاهش بیشتری می‌یابد. - سرعت راه رفتن در افراد با اختلالات شناختی خفیف در حالت راه رفتن همراه با یک فعالیت ذهنی نسبت به افراد سالم کمتر است و با گذشت زمان نیز کاهش بیشتری می‌یابد. - سرعت راه رفتن در افراد با اختلالات شناختی خفیف که منجر به بیماری آلزایمر در آینده می‌شود نسبت به افرادی که به بیماری ختم نمی‌شود، کمتر است.	[۱۴، ۹-۱۶]	سرعت راه رفتن	Walking(gait) speed
- طول گام در افراد با اختلالات خفیف و افراد با بیماری آلزایمر در حالت راه رفتن تک فعالیته و دوفعالیته نسبت به افراد سالم کاهش می‌یابد.	[۱۸، ۱۹، ۲۲]	طول گام	Step length
- تغییرپذیری طول گام در افراد با اختلالات خفیف نسبت به افراد سالم در زمان‌های اولیه راه رفتن (Gait initialization) کاهش می‌یابد.	[۱۹، ۳۱، ۳۵]	تغییرپذیری طول گام	Step length variability
- عدم تقارن طول گام در پاهای راست و چپ در افراد با بیماری آلزایمر نسبت به افراد سالم افزایش می‌یابد.	[۳۵]	عدم تقارن طول گام در پاهای چپ و راست	Step Length Asymmetry
- تفاوت برجسته‌ای میان عرض گام در گروه‌های مختلف مطالعه وجود ندارد.	[۹، ۱۰، ۱۸]	عرض گام	Step Width
- تغییرپذیری عرض گام در افراد با اختلالات خفیف نسبت به افراد سالم در زمان‌های اولیه راه رفتن (Gait initialization) کاهش می‌یابد.	[۹، ۱۹]	تغییرپذیری گام	Step width variability
- تفاوت برجسته‌ای میان ارتفاع گام در گروه‌های مختلف مطالعه وجود ندارد.	[۱۸]	ارتفاع گام	Step height
- زمان گام در افراد با بیماری آلزایمر نسبت به افراد سالم افزایش می‌یابد.	[۲۵]	زمان گام	Step time
- تغییرپذیری زمان گام در افراد با بیماری آلزایمر نسبت به افراد سالم کاهش می‌یابد.	[۳۵]	تغییرپذیری زمان گام	Step Time Variability
- عدم تقارن زمان گام در پاهای راست و چپ در افراد با بیماری آلزایمر نسبت به افراد سالم افزایش می‌یابد.	[۲۵]	عدم تقارن زمان گام در پاهای چپ و راست	Step Time Asymmetry

نتایج و یافته‌ها	مراجع	فارسی	انگلیسی	ویژگی
- تغییرپذیری سرعت گام در افراد با بیماری آزایمر نسبت به افراد سالم افزایش می‌یابد.	[۲۵]	تغییرپذیری سرعت گام		Step Velocity Variability
- طول چرخه راه رفتن در افراد با بیماری آزایمر و سایر دماسننس نسبت به افراد سالم و افراد با اختلالات خفیف کاهش می‌یابد.	[۱۳، ۱۰، ۹]	طول چرخه راه رفتن		Stride Length
- طول چرخه گام در افراد با اختلالات شناختی خفیف نسبت به افراد سالم در حالت راه رفتن دوگانه نسبت به حالت راه رفتن یگانه کاهش بیشتری دارد.	[۲۱، ۱۷، ۱۴] [۳۴، ۲۶]	عرض چرخه راه رفتن		Stride length variability
- تغییرپذیری طول چرخه راه رفتن در افراد با بیماری آزایمر نسبت به افراد سالم کاهش می‌یابد.	[۹]	زمان چرخه راه رفتن		Stride width
- تفاوت برجسته‌ای میان گروه‌های مختلف مطالعه (سالم، اختلالات خفیف و افراد با بیماری آزایمر) در عرض چرخه راه رفتن نمی‌شود.	[۲۶]	زمان چرخه راه رفتن		Stride time
- زمان چرخه راه رفتن در افراد با اختلالات خفیف و افراد با بیماری آزایمر نسبت به افراد سالم کاهش می‌یابد.	[۲۱، ۱۶، ۱۵]	زمان چرخه راه رفتن		Variability of stride time
- تغییرپذیری زمان چرخه راه رفتن در افراد با اختلالات شناختی ضعیف و افراد با بیماری آزایمر در راه رفتن با سرعت معمولی (طبیعی) تفاوت خاصی ندارد.	[۱۶، ۱۵، ۱۱] [۲۱]	فرکانس چرخه راه رفتن		stride frequency
- تغییرپذیری چرخه راه رفتن در افراد با اختلالات خفیف و افراد با بیماری آزایمر نسبت به افراد سالم در راه رفتن با سرعت‌های مختلف افزایش می‌یابد.	[۱۷، ۱۴، ۱۳] [۲۱]	نظم در چرخه راه رفتن		stride regularity
- فرکانس چرخه راه رفتن در افراد با اختلالات خفیف و افراد با بیماری آزایمر نسبت به افراد سالم کاهش می‌یابد و در حالت راه رفتن دوگانه نسبت به راه رفتن یگانه این کاهش شدت بیشتری دارد.	[۲۴، ۱۴، ۱۳]	تقارن چرخه راه رفتن		stride symmetry
- نظم در چرخه راه رفتن در افراد با اختلالات شناختی خفیف که به بیماری آزایمر ختم می‌شود نسبت به افرادی که به بیماری آزایمر مبتلا نمی‌شوند، در حالت راه رفتن دوگانه کاهش می‌یابد.	[۱۴]	تعداد دفعات توقف در راه رفتن		number of stop in walking
- تقارن در چرخه راه رفتن در افراد سالم نسبت به افراد با بیماری آزایمر و افراد با اختلالات شناختی خفیف به مرتب بیشتر است.	[۲۴، ۱۴، ۱۳]	زمان ایستادن در چرخه راه رفتن		stance time
- تقارن چرخه راه رفتن در افراد با اختلالات خفیف که به بیماری آزایمر منجر می‌شود، نسبت به افرادی که اختلالات شناختی خفیف آنها به بیماری آزایمر ختم نمی‌شود، در هنگام راه رفتن دوگانه کاهش می‌یابد.	[۲۶، ۲۲، ۲۱] [۳۵]	درصد زمان ایستادن (نسبت زمان ایستادن به زمان چرخه راه رفتن)		Percentage of stance time (time of the stance time/time of the gait cycle)
- مدت زمان مرحله ایستادن در چرخه راه رفتن در افراد با اختلالات خفیف و نیز بیماری آزایمر نسبت به افراد سالم افزایش می‌یابد.	[۳۵]	تغییرپذیری زمان ایستادن		Stance Time Variability
- درصد زمان ایستادن در افراد با بیماری آزایمر نسبت به افراد سالم افزایش می‌یابد.	[۲۱، ۱۷]	عدم تقارن زمان ایستادن		Stance Time Asymmetry
- تغییرپذیری زمان ایستادن در چرخه راه رفتن در افراد با بیماری آزایمر نسبت به افراد سالم بیشتر است.	[۳۵، ۲۱، ۱۷]	زمان جابجایی پا در چرخه راه رفتن		swing time
- عدم تقارن زمان ایستادن در چرخه راه رفتن در افراد با بیماری آزایمر نسبت به افراد سالم بیشتر است.	[۳۵]			
زمان جابجایی در چرخه راه رفتن در افراد با بیماری آزایمر در حالت راه رفتن یگانه و دوگانه نسبت به افراد سالم بیشتر است.	[۲۶، ۲۱، ۱۹] [۳۵]			
- زمان جابجایی در چرخه راه رفتن در افراد با اختلالات شناختی در حالت راه رفتن دوگانه با یک چالش ذهنی نسبت به افراد سالم بیشتر است.				

نتایج و یافته‌ها	مراجع	فارسی	انگلیسی	ویژگی
- تغییرپذیری زمان جابجایی در چرخه راه رفتن در افراد با بیماری آلزایمر نسبت به افراد سالم بیشتر است.	[۲۱]	تغییرپذیری زمان جابجایی در چرخه راه رفتن	Variability of swing time	
- عدم تقارن زمان جابجایی در چرخه راه رفتن در افراد با بیماری آلزایمر نسبت به افراد سالم بیشتر است.	[۳۵]	عدم تقارن زمان جابجایی در چرخه راه رفتن	Swing Time Asymmetry	
- زمان پشتیبانی دو پا در چرخه راه رفتن در افراد با بیماری آلزایمر و سایر انواع دماسن نسبت به افراد سالم بیشتر است.	[۲۶، ۱۰]	زمان پشتیبانی دو پا در چرخه راه رفتن	double limb support time (DLS)	
- مقدار (DLS/SLS) در افراد با بیماری آلزایمر و سایر انواع دماسن نسبت به افراد سالم بیشتر است.	[۲۶]	نسبت زمان پشتیبانی دو پا به یک پا در چرخه راه رفتن	double/single limb support time ratio (DLS/SLS)	
- با افزایش میزان شدت اختلالات شناختی مقدار WSR نیز کاهش می‌یابد.	[۳۳]	سرعت تغییر از حالت سرعت معمولی به سرعت زیاد در راه رفتن	Walking speed reserve (WSR)	
- هزینه راه رفتن دوگانه در افراد با اختلالات شناختی خفیف که به دماسن و از جمله بیماری آلزایمر ختم می‌شود نسبت به افرادی که به بیماری آلزایمر و سایر انواع دماسن منجر نمی‌شود، بیشتر است.	[۲۸]	هزینه راه رفتن دوگانه(نسبت اختلاف سرعت در حالت راه رفتن یگانه و دوگانه به راه رفتن دوگانه بصورت درصد)	dual-task gait cost= ([single-task gait velocity – dual-task gait velocity] / single-task gait velocity) × 100	
- متوسط امتیاز تشابه در راه رفتن یگانه نسبت به راه رفتن دوگانه در افراد با بیماری آلزایمر نسبت به افراد سالم کمتر است که دهنده این مسئله است که راه رفتن افراد با بیماری آلزایمر تحت تأثیر بیشتر فشار ذهنی قرار می‌گیرد.	[۲۵]	تشابه الگوی راه رفتن در حالت تک فعالیته و دوفعالیته با چالش ذهنی	Gait similarity between single task walking and dual task walking	
- با کمک ویژگی‌های آماری سرعت زاویه‌ای و شتاب مفاصل پا هنگام راه رفتن می‌توان افراد با بیماری آلزایمر و افراد سالم را از هم تفکیک (طبقه‌بندی) کرد.	[۲۰]	ویژگی‌های آماری سرعت زاویه‌ای و شتاب مفاصل پا	Various statistical features from velocity and acceleration signals in each stride	

جدول ۳. طبقه‌بندی روش‌های آنالیز مورد استفاده در مطالعات پیشین که به آنالیز الگوی راه رفتن با هدف شناسایی و ارزیابی بیماری آلزایمر با تکیه بر روش‌های مبتنی بر آمار توصیفی، پردازش سیگنال و روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و شناسایی الگو پرداخته‌اند. همچنین هدف هر یک از روش‌های آنالیز استفاده شده در مطالعات پیشین نیز بیان شده است.

نوع آنالیز	الگوریتم آنالیز (پردازش)	هدف پردازش	مراجع
آمار	analysis of variance (ANOVA)	محاسبه میانگین و واریانس ویژگی‌ها در گروه‌های مختلف مطالعه جهت مقایسه کلی	[۲۱، ۱۹، ۱۸، ۱۳-۱۶، ۹-۱۱] [۳۳-۳۵، ۳۱، ۳۰، ۲۸، ۲۷، ۲۵]
توصیفی	Correlations analysis	آنالیز همبستگی به منظور یافتن ارتباط میان ویژگی‌های استخراجی از راه رفتن و نمرات آزمون‌های کلینیکی مانند آزمون MMSE	[۳۵، ۳۴، ۳۱، ۲۷، ۱۴، ۱۰، ۹]
آمار	Regression	آزمون رگرسیون به منظور تخمین نمرات آزمون‌های کلینیکی بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از راه رفتن افراد	[۳۲، ۲۸-۳۰، ۱۱]
آمار	T tests	بررسی وجود اختلاف برجسته میان داده‌های گروه‌های مختلف سالم، اختلالات شناختی خفیف و افراد با بیماری آلزایمر	[۲۹، ۲۲، ۱۸، ۱۶، ۱۱]
آمار	chi square test	مقایسه توزیع ویژگی‌های راه رفتن میان گروه‌های مختلف مطالعه	[۳۱، ۳۰، ۲۷، ۱۶، ۱۲-۱۴]
آمار	Mann-Whitney U tests	مقایسه ویژگی‌های غیرپارامتریک استخراجی از راه رفتن در گروه‌های مختلف مطالعه	[۳۵، ۲۶، ۲۴، ۲۲، ۱۲]
آمار	ICC test	بررسی پایایی و تکرارپذیری آزمون‌های مختلف راه رفتن برای ارزیابی شناختی و کارکردی گروه‌های مختلف مطالعه	[۱۲]
آمار	Kruskal-Wallis test	آنالیز غیرپارامتریک ویژگی‌های استخراجی از راه رفتن در گروه‌های مختلف مطالعه	[۲۷، ۲۶، ۱۳]
آمار	Friedman's test	آنالیز غیرپارامتریک ویژگی‌های مانند زمان گذر در چرخه راه رفتن که توزیع غیرنرمال دارد، به منظور تعیین اختلاف میان گروه‌های مختلف مطالعه	[۳۰، ۱۸]
آمار	Wilcoxon's signed rank test	یک روش غیرپارامتریک برای مقایسه میانگین ویژگی‌های استخراجی از راه رفتن در گروه بیمار با گروه سالم به عنوان مرجع مقایسه	[۲۹، ۱۸]
آمار	Shapiro-Wilk test	بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده‌های ثبت شده از راه رفتن گروه‌های مختلف مطالعه	[۳۴، ۲۲]
پردازش	Windowing	پنجه‌گذاری به منظور انتخاب بخشی از سیگنال‌های ثبت شده از راه رفتن افراد	[۲۱، ۱۷]
پردازش	Average Filtering	فلتر میانگین به منظور حذف نویز از سیگنال‌های ثبت شده از راه رفتن افراد	[۲۱، ۲۰، ۱۷]
سیگنال	Thresholding	آستانه‌گذاری به منظور تعیین مقادیر بزرگتر و کوچکتر از یک حد آستانه در سیگنال‌های راه رفتن به منظور تعیین محدوده چرخه راه رفتن	[۲۱، ۲۰، ۱۷]

نوع آنالیز	الگوریتم آنالیز(پردازش)	هدف پردازش	مراجع
sequential forward selection (SFS)	الگوریتم انتخاب ویژگی به روش انتخاب سلسله مراتبی	[۲۰]	
dynamic time warping (DTW) algorithm	مقایسه الگوی راه رفتن افراد سالم و بیمار بواسیله الگوریتم DTW با تبدیل کردن سیگنال‌های ثبت شده از راه رفتن افراد به سری‌های زمانی	[۳۲، ۲۲]	
Hidden Markov Model(HMM)	مدلسازی راه رفتن افراد بواسیله مدل مخفی مارکوف به منظور مقایسه راه رفتن گروه‌های مختلف مطالعه در حالت راه رفتن یگانه و دوگانه	[۲۵]	شناسایی
Support Vector Machine(SVM)	طبقه‌بندی(تفکیک) گروه‌های سالم و بیمار از هم بواسیله طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان (SVM) بواسیله ویژگی‌های استخراج شده از راه رفتن افراد مورد مطالعه	[۲۳]	الگو و هوش
Random Forest(RF)	طبقه‌بندی(تفکیک) گروه‌های سالم و بیمار از هم بواسیله طبقه‌بند جنگل تصادفی (RF) بواسیله ویژگی‌های استخراج شده از راه رفتن	[۲۳]	مصنوعی
probabilistic neural networks (PNNs)	طبقه‌بندی(تفکیک) گروه‌های سالم و بیمار از هم بواسیله طبقه‌بند شبکه عصبی احتمالاتی (PNN) بواسیله ویژگی‌های استخراج شده از راه رفتن افراد مورد مطالعه	[۲۰]	

بیماری آلزایمر به منظور پیشگیری از رشد سریع و غیر قابل برگشت و درمان پذیر بیماری، در این پژوهش با هدف شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر، مطالعات پیشینی که به آنالیز الگوی راه رفتن با استفاده از سنسورها و روش‌های پردازشی مبتنی بر فناوری اطلاعات پرداخته بودند، بررسی شدند.

بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که در کنار تفاوت در نوع تست‌های فیزیکی مورد استفاده برای مطالعه، گروه‌های مورد مطالعه از نظر شدت بیماری، شرایط سنی و ...، سیستم‌های سخت‌افزاری مورد استفاده برای ثبت داده‌ها، هدف نهایی و کاربرد سیستم پیشنهادی و الگوریتم‌های مورد استفاده برای پردازش داده‌های ثبت شده با هم تفاوت دارند. بنابراین در ادامه مطالعات پیشین که در این مقاله مروری بررسی شده بودند، از جنبه‌های فوق مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در حوزه آنالیز راه رفتن مطالعات پیشین با نگاهی پزشکی عمدتاً به آنالیز الگوی راه رفتن پرداخته‌اند. در این مطالعات سعی بر یافتن ارتباط میان الگوی راه رفتن و بیماری آلزایمر و یافتن ویژگی‌هایی در الگوی راه رفتن بوده که می‌توانند نشانگری برای شناسایی و بررسی فرآیند تغییرات بیماری باشد. عده سیستم‌های مورد استفاده نیز با تکیه بر سنسورهای نصب شده در کف اتاق که تحت عنوان سیستم GaitRite شناخته می‌شود و یا در برخی موارد نیز با تکیه بر سنسورهای پوشیدنی مانند شتاب‌سنج، زیروسکوپ و ... بوده است. اگر چه سیستم‌های مبتنی بر سنسورهای کف و پوشیدنی در ثبت راه رفتن در حوزه بیماری آلزایمر به‌طور گسترشده استفاده می‌شود ولی این سیستم‌ها با چالش‌هایی مانند نویز پذیری سیگنال‌ها، ایجاد مزاحمت و محدودیت برای افراد مورد مطالعه روبرو هستند. با توسعه سیستم‌های مبتنی بر پردازش تصویر در سال‌های اخیر، دوربین‌های عمقی مانند کینکت دارای قابلت بسیار خوبی از نظر استخراج اطلاعات عمقی و اسکلتی از بدن شخص در کنار تصاویر رنگی (RGB) در زمینه‌های آنالیز راه رفتن در

بحث و نتیجه‌گیری

بیماری آلزایمر به عنوان یک بیماری تخریبگر مغزی و شایع‌ترین عامل دمанс در سالمندان، به دلیل عدم وجود درمان، هزینه‌های بالای نگهداری از سالمندان با این بیماری و فرآیند رو به رشد آن در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. در کنار اختلالات شناختی که به‌خاطر بیماری آلزایمر در بخش‌های مختلف حافظه مانند فراموشی به وجود می‌آید، عملکرد فیزیکی افراد نیز دچار نقصان می‌شود. اختلالات به وجود آمده در توانایی‌های شناختی و فیزیکی افراد در مراحل اولیه بیماری بسیار خفیف بوده و به راحتی قابل تشخیص نیست. هم‌چنین به‌خاطر سالمند بودن افراد، میان ویژگی‌های اختلالی در توانایی‌های فیزیکی ناشی از بیماری و سالمندی فرد هم‌بوشانی و تشابه زیادی وجود دارد. به‌طور مثال کاهش سرعت راه رفتن هم ناشی از کهولت سن و هم ناشی از بیماری آلزایمر می‌تواند باشد. هم‌چنین تفاوت‌هایی که در شرایط روحی، سن، تحصیلات، سبک زندگی، جنسیت میان افراد سالمند وجود دارد، الگوی تغییرات در رفتار و شرایط فیزیکی افراد را متنوع و گسترده کرده است. به همین دلیل شناسایی زودهنگام بیماری به‌خاطر عواملی مانند مسائل اشاره شده در فوق با پیچیدگی بسیار زیادی همراه خواهد بود.

در بین روش‌های مختلف شناسایی بیماری آلزایمر، روش‌های مبتنی بر آنالیز فعالیت‌های فیزیکی و گفتاری مانند الگوی راه رفتن به دلیل غیر تهاجمی بودن، کم‌هزینه‌تر بودن و امکان انجام آن در محیط‌های غیر کلینیکی و آزمایشگاهی در سال‌های اخیر مورد توجه جدی‌تری نسبت به سایر روش‌ها گرفته است. مطالعات مختلف انجام شده نشان می‌دهد که تغییرات در الگوی راه رفتن، تعادل و فعالیت‌های روزمره زندگی می‌تواند به عنوان یکی از فعالیت‌های فیزیکی، نشانگر اولیه‌ای برای شناسایی و ارزیابی شناختی و کارکردی در حوزه بیماری آلزایمر در افراد سالمند باشد. با توجه به اهمیت شناسایی زودهنگام

توصیفی مانند روش آنالیز رگرسیون، آنالیز به کمک آزمون‌هایی مانند آزمون t و آزمون MWU برای مقایسه گروه‌های مورد مطالعه از نظر وجود تفاوت میان آن‌ها برای ویژگی‌های مختلف راه رفتن بوده است. ولی تعداد محدودی مطالعه نیز از روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی با هدف شناسایی بیماری آلزایمر با کمک ویژگی‌های استخراجی از الگوی راه رفتن افراد سالم‌نیز پرداخته‌اند. به طور مثال، در مطالعه انجام شده توسط Wang et al (۲۰۱۴) که با استفاده از یک مازول پوشیدنی شامل سنسورهای شتاب‌سنج و ژیروسکوب به ثبت اطلاعات راه رفتن افراد سالم‌نیز با بیماری آلزایمر و سالم پرداخته بودند، پس از استخراج ویژگی‌های مختلف، با استفاده از شبکه عصبی احتمالاتی به تفکیک دو گروه سالم و بیمار پرداخته بودند [۱۹]. نتایج کمی حاصل دارای صحت و حساسیت Specificity٪۶۳/۳۳٪ و ٪۶۷٪ برای زنان و ٪۷۰٪ و ٪۷۲٪ برای مردان به ترتیب بوده است. در مطالعه انجام شده توسط Akl et al (۲۰۱۵) نیز که از سنسورهای تشخیص گروه سالم‌دان سالم و سالم‌دان با اختلالات شناختی ضعیف انجام شده بود، نتایج نهایی دارای دقت ٪۹۰/۶٪ و حساسیت ٪۷۹٪ بوده است [۳۴]. یافته‌های این مطالعات مبتنی بر یادگیری ماشین نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای این حوزه پردازشی می‌تواند کمک قابل قبولی برای ارزیابی کمی و شناسایی دقیق بیماری آلزایمر در سالم‌دان داشته باشد. بنابراین با توجه به پیچیدگی بیشتر و اهمیت شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر، به نظر می‌رسد که استفاده از روش‌های مبتنی بر سیستم‌های فازی به دلیل میهم بودن مرز میان گروه‌های سالم، اختلالات خفیف شناختی و بیماری آلزایمر خفیف برای طبقه‌بندی و شناسایی گروه‌های بیمار نتایج خوبی را نشان دهد.

به طور خلاصه اگر چه در مطالعات پیشین به آنالیز فعالیت‌های فیزیکی به عنوان ابزاری جدید برای شناسایی بیماری آلزایمر در سالم‌دان توجه شده و نتایج امیدوارکننده‌ای نیز به دست آمده است، اما به خاطر برخی کاستی‌ها و مشکلات نیاز به توسعه مطالعات در این زمینه ضروری است. به طور مثال سیستم‌های پیشینی که به تفکیک گروه‌های مطالعه پرداخته‌اند، عمدتاً بر روی گروه‌های سالم و بیمار در مرحله متوسط تا شدید، مطالعه خود را انجام داده‌اند. در صورتی که با توجه به نبود درمان برای بیماری آلزایمر و اهمیت شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر، مطالعه بر روی گروه‌های با اختلالات شناختی ضعیف و بیماری آلزایمر خفیف اهمیت بیشتری دارد. هم‌چنین به دلیل تشابه بسیار زیاد رفتار این گروه‌های خفیف با سالم‌دان سالم، پیچیدگی و چالش‌های موجود بسیار بیشتر از مطالعه بر روی

حوزه‌هایی مانند تشخیص هویت فرد و ... در حال استفاده و توسعه هستند. اما در حوزه شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر با استفاده از ثبت راه رفتن با این دوربین‌های عمیقی توجه چندانی نشده است. با توجه به قابلیت خوب نسل دوم دوربین کینکت در آشکارسازی مفاصل انسان، حساسیت کم به نور محیط و نویز، قابلیت ثبت تصاویر هم‌زمان چند نفر و تفکیک افراد از هم، استفاده از این دوربین‌ها برای ثبت راه رفتن افراد با بیماری آلزایمر نیز می‌تواند چالش‌های اشاره شده در فوق را که در سیستم‌های پیشین وجود دارد برطرف نماید. از طرفی به دلیل ارائه تصویر اسکلتی شخص، قابلیت اندازه‌گیری ویژگی‌هایی گسترده‌تر از سیستم‌های پیشین فراهم می‌شود. به طور مثال علاوه بر اندازه‌گیری ویژگی‌های مانند محل گام، سرعت گام، فاصله گام و ... می‌توان ویژگی‌هایی مانند تعییرات زاویه مفاصل را نیز اندازه‌گیری کرد. هم‌چنین به دلیل تکیه بر اطلاعات اسکلتی افراد در مطالعه الگوی راه رفتن، مسأله حریم خصوصی و امنیت افراد نیز به دلیل عدم قابلیت تشخیص هویت فرد، رعایت می‌شود. از طرفی به دلیل نصب ثابت دوربین کینکت در محل، نیاز به تنظیمات مجدد سنسورها و انجام تنظیمات پیچیده سیستم وجود ندارد.

بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که در هر کدام از مطالعات پیشین تعدادی ویژگی به منظور بررسی یافتن نشانگرهایی برای شناسایی بیماری آلزایمر در سالم‌دان مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی‌هایی مانند مدت زمان انجام آزمون راه رفتن، سرعت متوسط راه رفتن، طول گام، طول چرخه راه رفتن، زمان چرخه راه رفتن، سرعت چرخه راه رفتن و نیز تعییرپذیری ویژگی‌های طول گام، طول چرخه راه رفتن و سرعت چرخه راه رفتن برای مقایسه عملکرد دو گروه سالم‌دان با بیماری آلزایمر و سالم‌دان سالم در آزمون راه رفتن تک فعالیته و دو فعالیته، عمده‌ترین ویژگی‌هایی بوده‌اند که مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اما مطالعه‌ای به منظور مقایسه ویژگی‌های مختلف برای یافتن بهینه‌ترین ویژگی‌ها برای شناسایی بیماری آلزایمر صورت نگرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از زمینه‌های جدیدی که در آینده باید بررسی شود، تعیین بهینه‌ترین ویژگی‌های الگوی راه رفتن برای شناسایی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی مانند الگوریتم زتیک است.

آخرین گام در مطالعات شناسایی بیماری آلزایمر با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن، پردازش ویژگی‌های استخراجی به کمک الگوریتم‌های مبتنی بر آمار توصیفی، شناسایی الگو و یادگیری ماشین است. در آنالیز داده‌های ثبت شده نیز چون عده هدف مطالعات پیشین، یافتن ارتباط بیماری آلزایمر با ویژگی‌های الگوی راه رفتن بوده است، بیشتر تکیه بر روش‌های آنالیز آمار

- [17] Chung P, Hsu Y, Wang C, Lin C, Wang J, Pai M. Gait analysis for patients with Alzheimer's disease using a triaxial accelerometer. Proceedings of the 2012 IEEE International Symposium on Circuits and Systems; 2012 May 20-23; Seoul, South Korea, p.1323-1326.
- [18] Cedervall Y, Halvorsen K, Aberg AC. A longitudinal study of gait function and characteristics of gait disturbance in individuals with Alzheimer's disease. *Gait Posture* 2014; 39: 1022-1027.
- [19] Boripuntakul S, Lord SR, Brodie MA, Smith ST, Methapatara P, Wongpakaran N, et al. Spatial variability during gait initiation while dual tasking is increased in individuals with mild cognitive impairment. *J Nutr Health Aging* 2014; 18: 307-312.
- [20] Wang WH, Hsu YL, Pai MC, Wang CH, Wang CY, Lin CW, et al. Alzheimer's disease classification based on gait information. Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN); 2014 July 6-11; Beijing, China, p.3251-3257.
- [21] Hsu YL, Chung PC, Wang WH, Pai MC, Wang CY, Lin CW, et al. Gait and balance analysis for patients with Alzheimer's disease using an inertial-sensor-based wearable instrument. *IEEE J Biomed Health Inform* 2014; 18: 1822-1830.
- [22] Gras LZ, Kanaan SF, McDowd JM, Colgrove YM, Burns J, Pohl PS. Balance and gait of adults with very mild Alzheimer disease. *J Geriatr Phys Ther* 2015; 38: 1-7.
- [23] Akl A, Taati B, Mihailidis A. Autonomous unobtrusive detection of mild cognitive impairment in older adults. *IEEE Trans Biomed Eng* 2015; 62: 1383-1394.
- [24] Gillain S, Drame M, Lekeu F, Wojtasik V, Ricour C, Crosier JL. Gait speed or gait variability, which one to use as a marker of risk to develop Alzheimer disease? A pilot study. *Aging Clin Exp Res* 2016; 28: 249-255.
- [25] Wang WH, Wu HL, Chung PC, Pai M. An HMM -based gait comparison: using Alzheimer's disease patients as examples. Proceedings of the 2015 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN); 2015 July 12-17; Killarney, Ireland: IEEE, p.1-6.
- [26] Rucco R, Agosti V, Jacini F, Sorrentino P, Varriale P, Stefano MD. Spatio-temporal and kinematic gait analysis in patients with Frontotemporal dementia and Alzheimer's disease through 3D motion capture. *Gait Posture* 2016; 52: 312-317.
- [27] Borges SD, Radanovic M, Forlenza OV. Correlation between functional mobility and cognitive performance in older adults with cognitive impairment. *Neuropsychol Dev Cogn B Aging Neuropsychol Cogn* 2016; 25: 23-32.
- [28] Montero-Odasso MM, Sarquis-Adamson Y, Speechley M, Borrie MJ, Hachinski VC, Wells J, et al. Association of dual-task gait with incident dementia in mild cognitive impairment. *JAMA Neurol* 2017; 74: 857-865.
- [29] Taylor ME, Lasschuit DA, Lord SR, Delbaere K, Kurkle SE, Mikolaizak AS, et al. Slow gait speed is associated with executive function decline in older people with mild to moderate dementia: a one year longitudinal study. *Arch Gerontol Geriatr* 2017; 73: 148-153.
- [30] MacAulay RK, Wagner MT, Szeles D, Milano NJ. Improving sensitivity to detect mild cognitive impairment: cognitive load dual-task gait speed assessment. *J Int Neuropsychol Soc* 2017; 23: 493-501.
- [31] König A, Klaming L, Pijl M, Demeurraux A, David R, Robert P. Objective measurement of gait parameters in healthy and cognitively impaired elderly using the dual-task paradigm. *Aging Clin Exp Res* 2017; 29: 1181-1189.
- [32] Varatharajan R, Manogaran G, Priyan MK. Wearable sensor devices for early detection of Alzheimer disease using dynamic time warping algorithm. *Cluster Comput* 2017; 1-10.
- [33] Callisaya ML, PLauin CP, Srikanth VK, Verghese J, Allali G, Beauchet O. Cognitive status, fast walking speed and walking speed reserve-the Gait and Alzheimer interactions tracking (GAIT) study. *Gero Sci* 2017; 39: 231-239.
- [34] Hausdorff JM, Hillel I, Shustak S, Din SD, Bekkers EM, Pelosin E. Everyday stepping quantity and quality among older adult fallers with and without mild cognitive impairment: initial evidence for new motor markers of cognitive deficits? *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2017; 73: 1-5.
- [35] Ardlea RM, Morris R, Hickey A, Dina SD, Koychev I, Gunn RN. Gait in mild Alzheimer's disease: feasibility of multi-center measurement in the clinic and home with body-worn sensors: a pilot study. *J Alzheimers Dis* 2018; 63: 331-341.
- [36] Lee L, Grimson WE. Gait analysis for recognition and classification. Proceedings of the Fifth IEEE International

گروههای با بیماری متوسط و شدید است. همچنین امروزه با ظهور تکنولوژی‌های جدیدتر در حوزه ثبت داده‌های فعالیت‌های فیزیکی بهوسیله ابزارهایی مانند دوربین‌های عمقی و بهره‌گیری از روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی امکان توسعه و ارائه سیستم‌ها و روش‌های نوینی که چالش‌هایی مانند تهاجمی بودن ابزار ثبت، وجود نویز در سیگنال‌ها، نیاز به حجم زیاد از سنسورها برای ثبت فعالیت‌های مختلف و ... می‌تواند بر طرف شود.

منابع

- [1] Alzheimer's Association Report. 2017Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimer's Dement* 2017; 13: 325-373.
- [2] Doost mohammad pour J, Hosseini mardi N, Janahmadi M, Ebrahimi S, Fathollahi Y, Motamed F. Induction of a rat model of Alzheimer's disease by amyloid- β did not change short term synaptic plasticity in CA1 area of hippocampus. *Koomesh* 2014; 16: 76-81. (Persian).
- [3] Ravari A, Mirzaei T, Salamizadeh A, Askari Majdabadi H. Effect of the spiritual care training on anxiety reduction in home caregivers of the elderly with Alzheimer disease. *Koomesh* 2017; 19: 467-474. (Persian).
- [4] Aramendi AA, Aztiria A, Basarab A. On the early diagnosis of Alzheimer's disease from multimodal signals: A survey. *Artif Intell Med* 2016; 71: 1-29.
- [5] IJmker T, Lamoth CJ. Gait and cognition: The relationship between gait stability and variability with executive function in persons with and without dementia. *Gait Posture* 2012; 35: 126-130.
- [6] Malouin F, Richards CL, Jackson PL, Dumas F, Doyon J. Brain activations during motor imagery of locomotor-related tasks: a PET study. *Hum Brain Mapp* 2003; 19: 47-62.
- [7] Nakamura T, Meguro K, Yamazaki H, Okuzumi H, Tanaka A, Horikawa A, et al. Postural and gait disturbance correlated with decreased frontal cerebral blood flow in Alzheimer disease. *Alzheimer Dis Assoc Disord* 1997; 11: 132-139.
- [8] Lam KY, Tsang WHN, Han S, Zhang W, Ng JK, Nath A. Activity tracking and monitoring of patients with alzheimer's disease. *Multimed Tools Appl* 2017; 76: 489-521.
- [9] Webster KE, Merory JR, Wittwer JE. Gait variability in community dwelling adults with Alzheimer disease. *Alzheimer Dis Assoc Disord* 2006; 20: 37-40.
- [10] Merory JR, Wittwer JE, Rowe CC, Webster KE. Quantitative gait analysis in patients with dementia with Lewy bodies and Alzheimer's disease. *Gait Posture* 2007; 26: 414-419.
- [11] Beauchet O, Allali G, Berrut G, Hommet C, Dubost V, Assal F. Gait analysis in demented subjects: Interests and perspectives. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2008; 4: 155-160.
- [12] Ries JD, Echternach JL, Nof L, Blodgett MG. Test-retest reliability and minimal detectable change scores for the timed "Up & Go" test, the six-minute walk test, and gait speed in people with Alzheimer disease. *Phys Ther* 2009; 89: 569-579.
- [13] Gillain S, Warzee E, Lekeu F, Wojtasik V, Maquet D, Crosier JL, et al. The value of instrumental gait analysis in elderly healthy, MCI or Alzheimer's disease subjects and a comparison with other clinical tests used in single and dual-task conditions. *Ann Phys Rehabil Med* 2009; 52: 453-474.
- [14] Maquet D, Lekeu F, Warzee E, Gillain S, Wojtasik V, Salmon E, et al. Gait analysis in elderly adult patients with mild cognitive impairment and patients with mild Alzheimer's disease: simple versus dual task: a preliminary report. *Clin Physiol Funct Imaging* 2010; 30: 51-56.
- [15] Choi JS, Oh HS, Kang DW, Mun KR, Choi MH, Lee SJ, et al. Comparison of gait and cognitive function among the elderly with Alzheimer's disease, mild cognitive impairment and healthy. *Int J Prec Engin Manufact* 2011; 12: 169-173.
- [16] Muir SW, Speechley M, Wells J, Borrie M, Gopaul K, Montero-Odasso M. Gait assessment in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: The effect of dual-task challenges across the cognitive spectrum. *Gait Posture* 2012; 35: 96-100.

- [42] Tao W, Liu T, Zheng R, Feng H. Gait analysis using wearable sensors. *Sensors* 2012; 12: 2255-2283.
- [43] Schneider B, Banerjee T. Activity recognition using imagery for smart home monitoring. *Adv Soft Comput Machine Learn Image Proc Studi Comput Int* 2017; 730: 355-371.
- [44] Do TN, Suh YS. Gait analysis using floor markers and inertial sensors. *Sensors* 2012; 12: 1594-1611.
- [45] Middleton L, Buss AA, Bazin A, Nixon MS. A floor sensor system for gait recognition. *Proceedings of the Fourth IEEE Workshop on Automatic Identification Advanced Technologies*; 2005 Oct 17-18; Buffalo, NY, USA, p.171-176.
- [46] Chen SW, Lin SH, Liao LD, Lai HY, Pei YC, Kuo TS, et al. Quantification and recognition of parkinsonian gait from monocular video imaging using kernel based principal component analysis. *Biomed Eng Online* 2011; 10: 1-21.
- [47] Imani Z, Soltanizadeh H. Person reidentification using local pattern descriptors and anthropometric measures from videos of Kinect sensor. *IEEE Sensors J* 2016; 16: 6227-6238.
- Conference on Automatic Face and Gesture Recognition; 2002 May 21-21; Washington, DC, USA, p.1-8.
- [37] Valkanova V, Ebmeier K P. What can gait tell us about dementia? Review of epidemiological and neuropsychological evidence. *Gait Posture* 2017; 53: 215-223.
- [38] Pirker W, Katzenbachler R. Gait disorders in adults and the elderly: A clinical guide. *Wien Klin Wochenschr* 2017; 129: 81-95.
- [39] Pourghayoomi E, Negahdar F, Shahidi G, Mehraban AH, Ebrahimi I, Taghizadeh G, et al. Correlation between functional balance and mobility tests and postural sway measures in dual task paradigm in Parkinson's disease (a pilot study). *J Basic Clin Pathophysiol* 2014; 2: 1-12.
- [40] Allan LM, Ballard C G, Burn D J, Kenny RA. Prevalence and severity of gait disorders in Alzheimer's and non-Alzheimer's dementias. *J Am Geriatr Soc* 2005; 53: 1681-1687.
- [41] Herran AM, Garcia-Zapirain B, Mendez-Zorrilla A. Gait analysis methods: an overview of wearable and non-wearable systems, highlighting clinical applications. *Sensors* 2014; 14: 3362-3395.

Review Article

A survey on Alzheimer's disease detection using gait analysis

Mahmoud Seifallahi (Ph.D Candidate)¹, Hadi Soltanizadeh (Ph.D)^{*1}, Afsoon Hassani Mehraban (Ph.D)², Fatemeh Khamseh (M.D)³

1 - Dept. of Electronic Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University, Semnan, Iran

2 - Dept. of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences and Health Sciences, Tehran, Iran

3- Neurologist, Iran Alzheimer's Association, Tehran, Iran

* Corresponding author. +98 9126275300 h_soltanizadeh@semnan.ac.ir

Received: 25 Sep 2018; Accepted: 25 Jun 2019

Introduction: Early detection of Alzheimer's disease (AD), as a neurodegenerative disease and the most common cause of dementia in the elderly people, using gait analysis have been particularly noted by researcher in recent years. Because this novel method is non-invasive, less cost, and feasible in non-clinical and laboratory environments. Therefore, in this Meta-Analysis review article, detection of AD using gait analysis based on information technology tools surveyed in previous studies.

Materials and Methods: The search for previous articles was done in databases such as Google Scholar, Pubmed, IEEE, Springer, and Elsevier. After finding articles in these databases, appropriate articles were selected to survey based on criteria such as focusing of the study on elderly patients with AD or mild cognitive impairment, the detection and assessment of AD, and the use of sensor technology to record gait.

Results: AD can be detected, even in the early stages and also at a stage of mild cognitive impairment based on gait analysis using new technologies with sensors and information technologies. Also, it is possible to quantitatively evaluate and more accurately detect the disease based on the combination of different sensor technologies and the use of artificial intelligence techniques.

Conclusion: Although gait analysis can be a novel tool for early detection of AD, but it is essential to be developed and improved based on sensors and artificial intelligence in order to be used as a reliable clinical tools.

Keywords: Alzheimer Disease, Gait, Information Technology, Computer-Assisted Image Processing, Machine Learning, Artificial Intelligence